

MEDVIE

Date du test: 11/03/2024 14:14:03

Durée: 9mn 17s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

DIOUBATE OUMAR

Date de naissance 30/12/1976

Age 47

Société COVEC


ID 24031114110655494

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

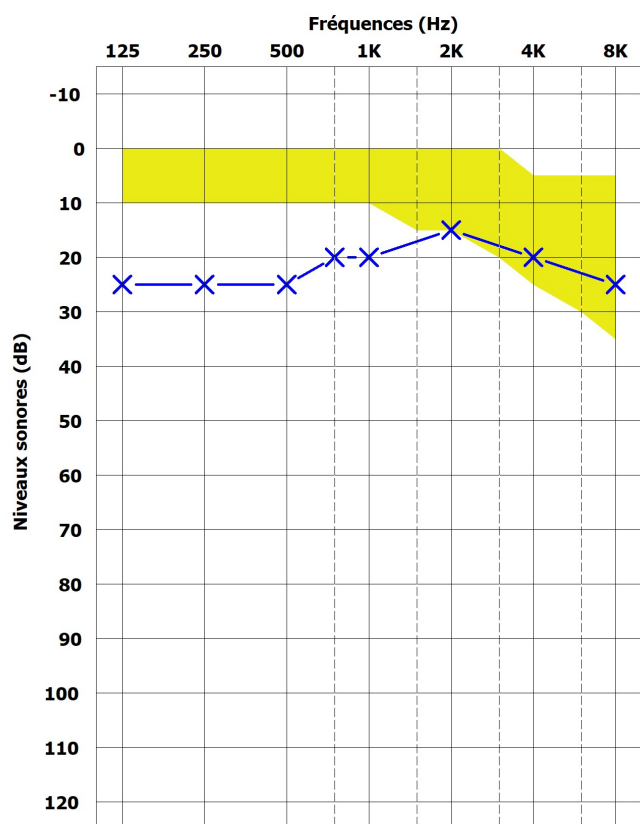

Oreille Gauche

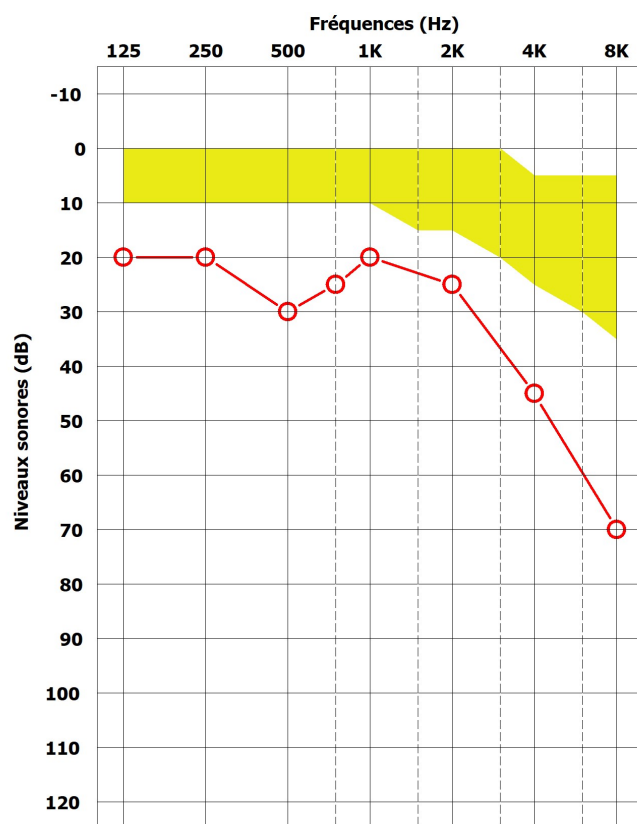

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	25	25	20	20		15		20		25
CA Droit	20	20	30	25	20		25		45		70

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	30,0 dB	---

Notes