


MEDVIE

Date du test: 24/07/2024 13:17:17

Durée: 6mn 06s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

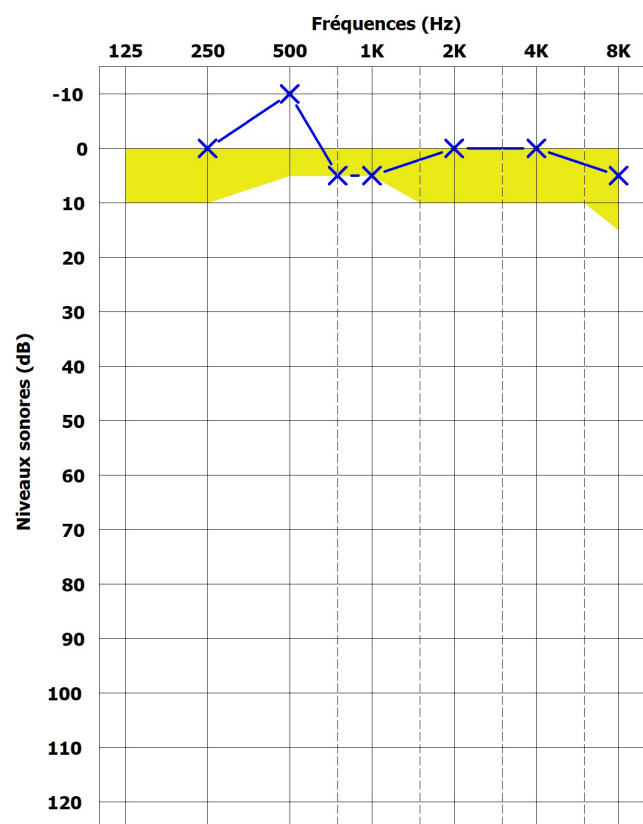

Oreille Gauche

Données Patient	
DOUMBOUYA FODE	
Date de naissance	11/10/1993
Age	30
Société	COVEC
ID	24072413151740571

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

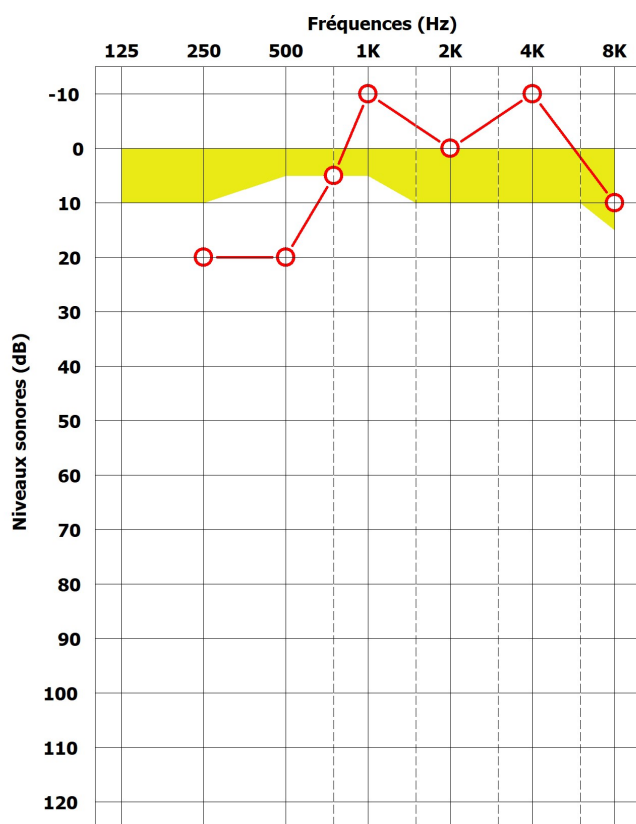

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	-10	5	5		0		0		5
CA Droit		20	20	5	-10		0		-10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	-1,3 dB	---
CA Droit	0,0 dB	---

Notes