

MEDVIE

Date du test: 21/02/2024 11:41:05

Durée: 4mn 50s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

TRAORE ADAMA

Date de naissance

01/01/1979

Age

45

Société

COVEC

ID

24022111343579067

Audiomètre

Type:


Audio 820M V2,211

Numéro de série:


2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021

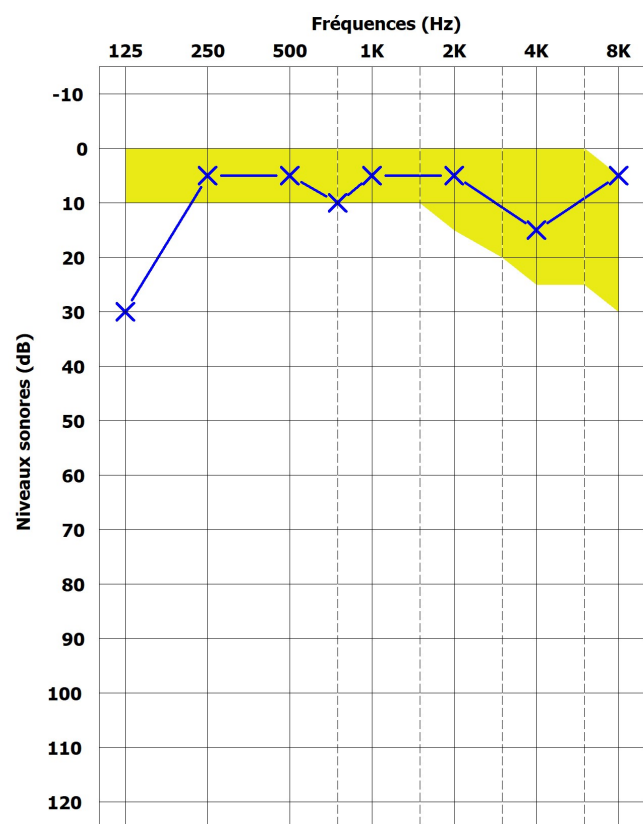

Oreille Gauche

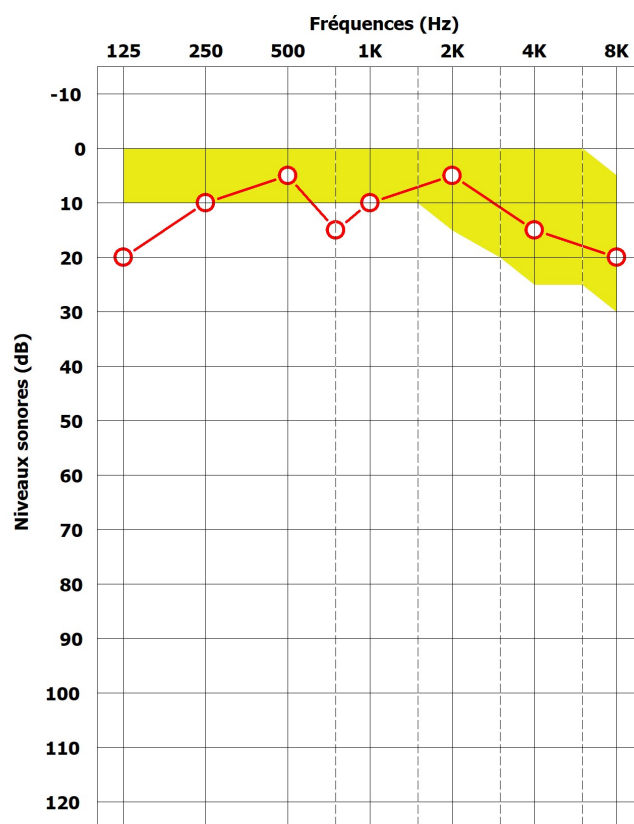

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	5	5	10	5		5		15		5
CA Droit	20	10	5	15	10		5		15		20

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes