

MEDVIE


Date du test: 24/02/2024 12:10:06

Durée: 6mn 23s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CAMARA KARAMO
Date de naissance	01/01/1994	
Age	30	
Société	COVEC	
ID	24022412053411840	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

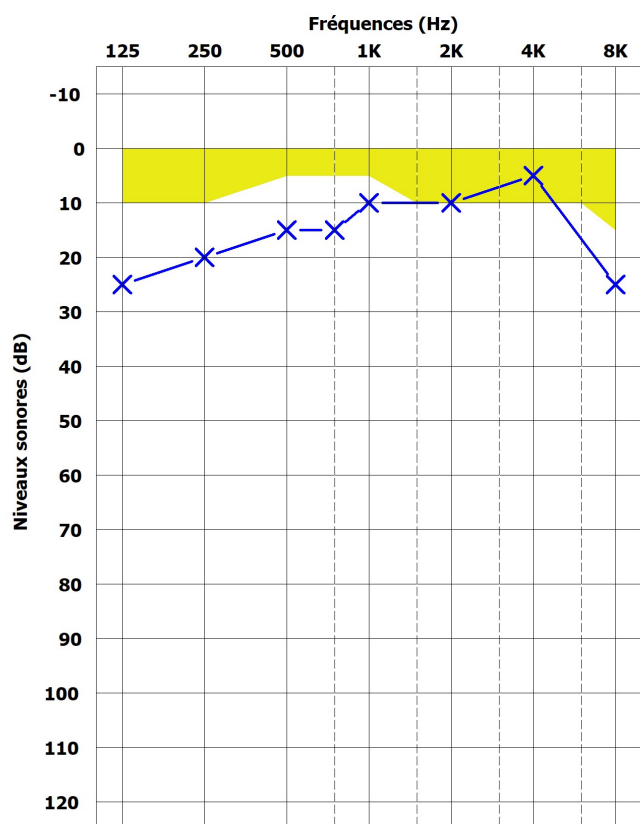

Oreille Gauche

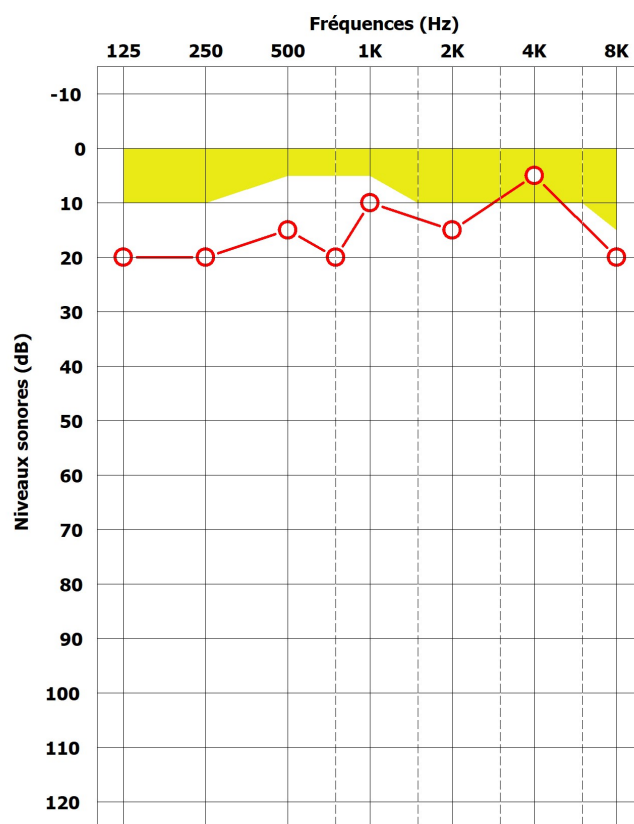

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	20	15	15	10		10		5		25
CA Droit	20	20	15	20	10		15		5		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes