

MEDVIE


Date du test: 19/02/2024 14:16:34

Durée: 5mn 32s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SOUMAORO MAMADY	
Date de naissance	01/01/1977
Age	47
Société	COVEC
ID	24021914142777929

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

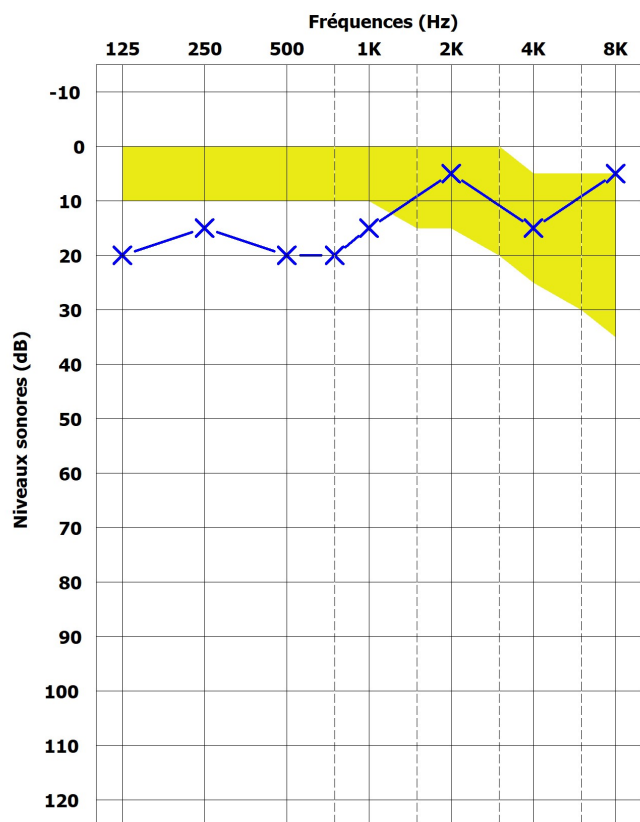

Oreille Gauche

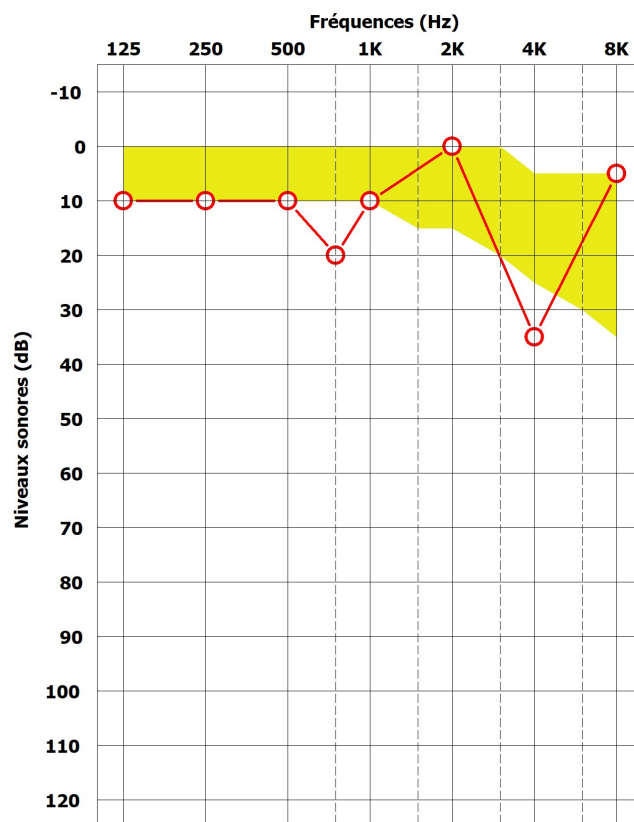

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	20	20	15		5		15		5
CA Droit	10	10	10	20	10		0		35		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes