

MEDVIE


Date du test: 24/02/2024 18:34:48

Durée: 6mn 41s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	FOFA SIDIKI
Date de naissance	10/01/1990
Age	34
Société	COVEC
ID	24022418323609982

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

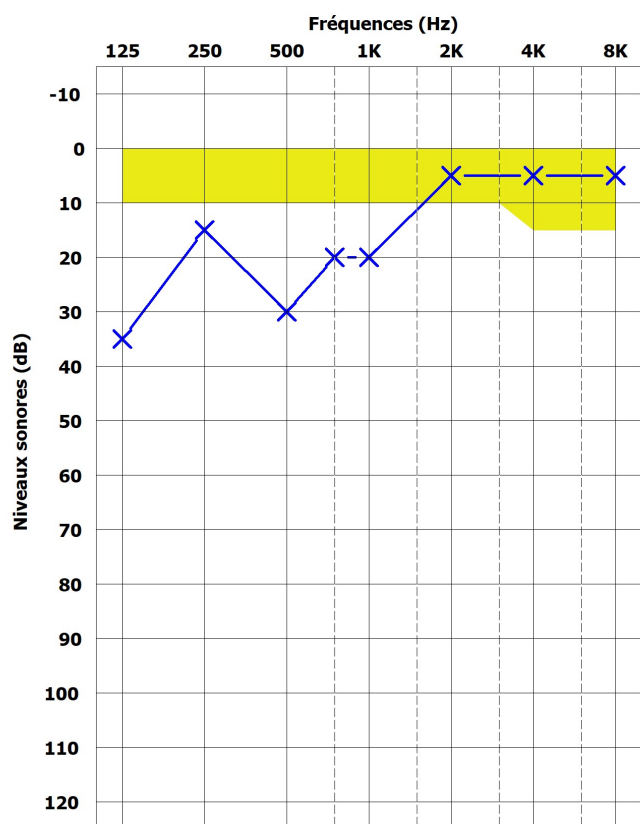

Oreille Gauche

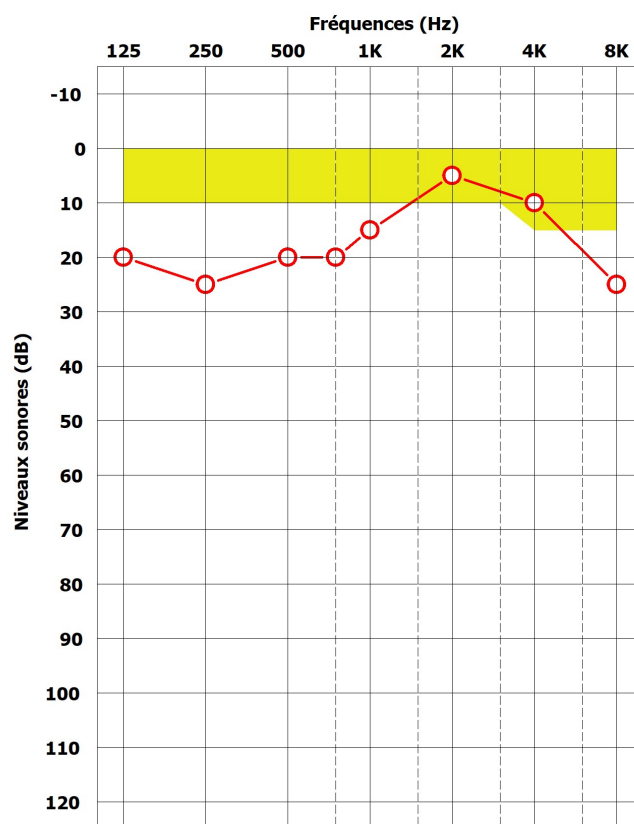

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	15	30	20	20		5		5		5
CA Droit	20	25	20	20	15		5		10		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes