


MEDVIE


Date du test: 23/02/2024 11:02:42

Durée: 4mn 10s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

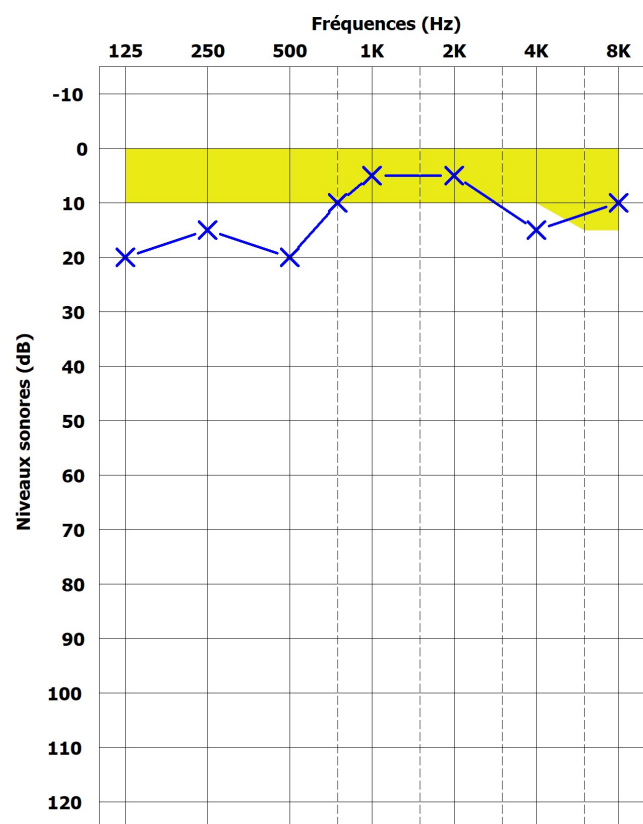

Oreille Gauche

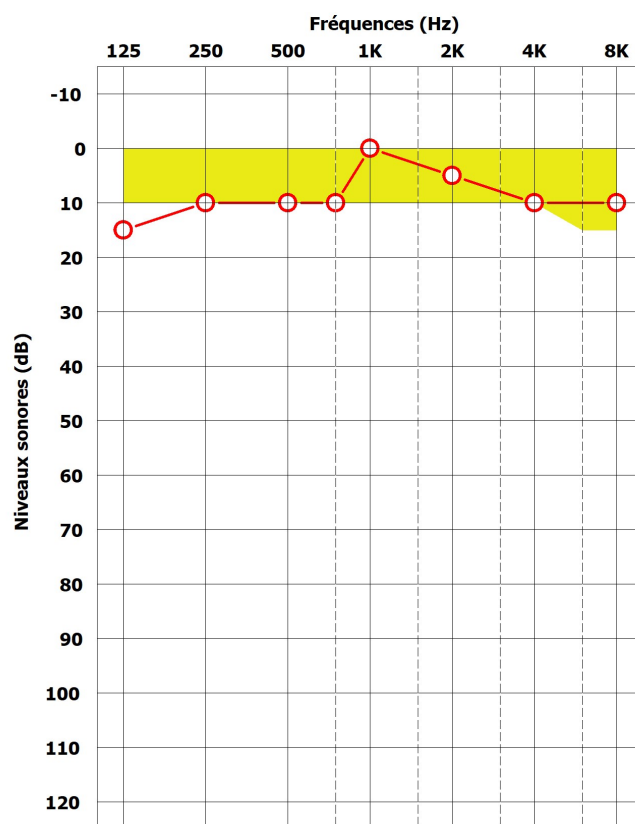

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	20	10	5		5		15		10
CA Droit	15	10	10	10	0		5		10		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes

Données Patient	TRAORE MOUSTAPHA
Date de naissance	01/01/1992
Age	32
Société	COVEC
ID	24022310555591836

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021