


MEDVIE

Date du test: 30/08/2024 12:16:48

Durée: 5mn 52s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

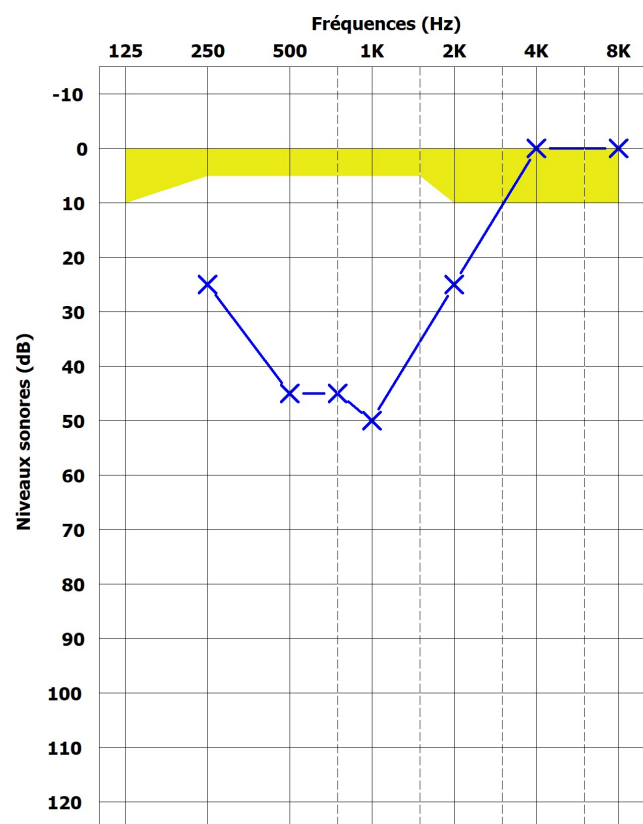

Oreille Gauche

Données Patient	
	DIALLO MAMADOU SAMRA I
Date de naissance	01/01/1998
Age	26
Société	COVEC
ID	24083012065687306

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

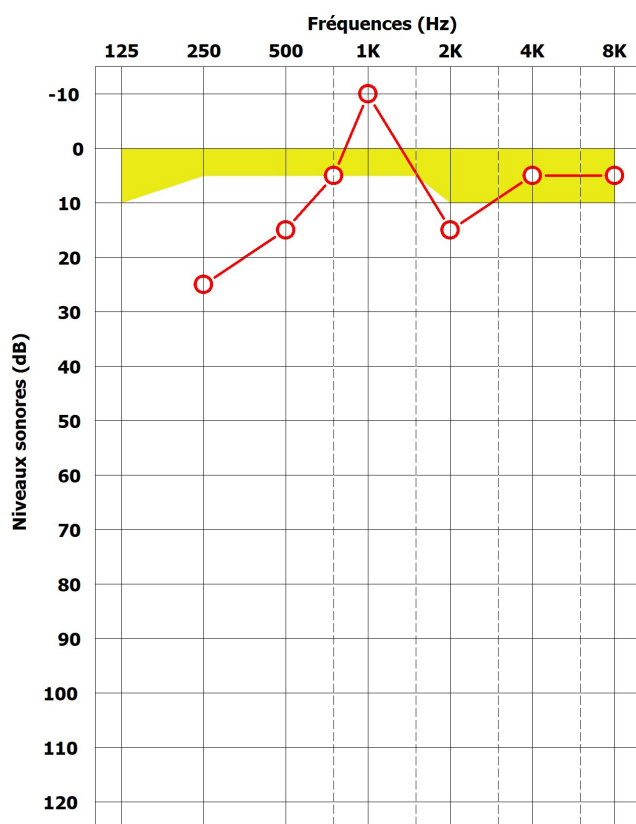

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	45	45	50		25		0		0
CA Droit		25	15	5	-10		15		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	30,0 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes