


MEDVIE


Date du test: 06/05/2024 14:46:50
Durée: 4mn 02s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
MITTE MAMOUDOU	
Date de naissance	01/01/1985
Age	39
Société	COVEC278
ID	24050614381684316

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

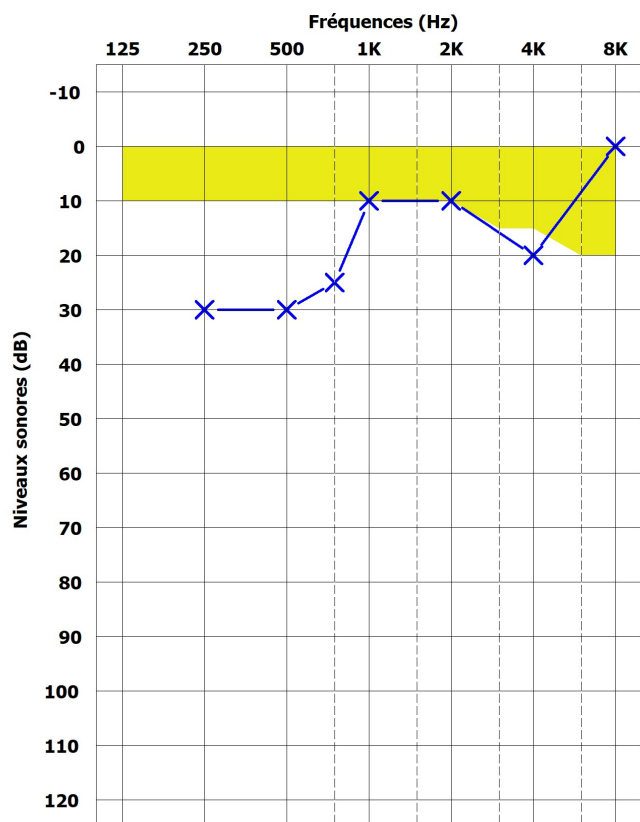

Oreille Gauche

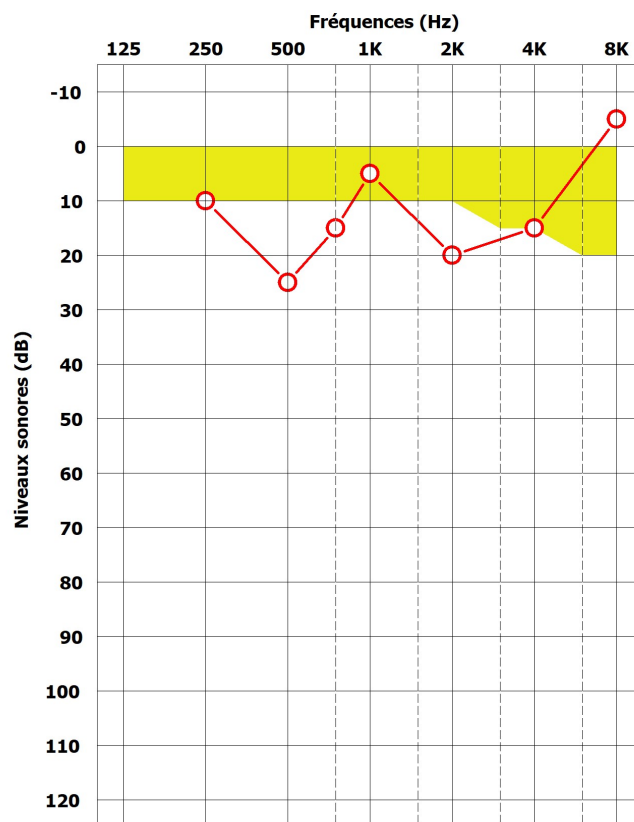

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	25	10		10		20		0
CA Droit		10	25	15	5		20		15		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes