


MEDVIE


Date du test: 20/02/2024 10:11:30
Durée: 5mn 24s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SIDIBE OUSMANE
Date de naissance	17/09/1998
Age	25
Société	COVEC
ID	24022010054157596

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

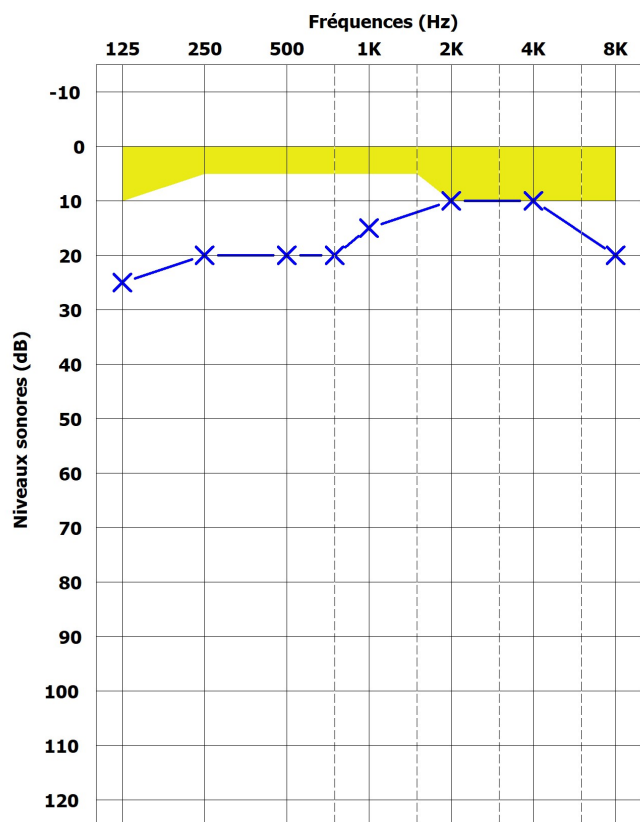

Oreille Gauche

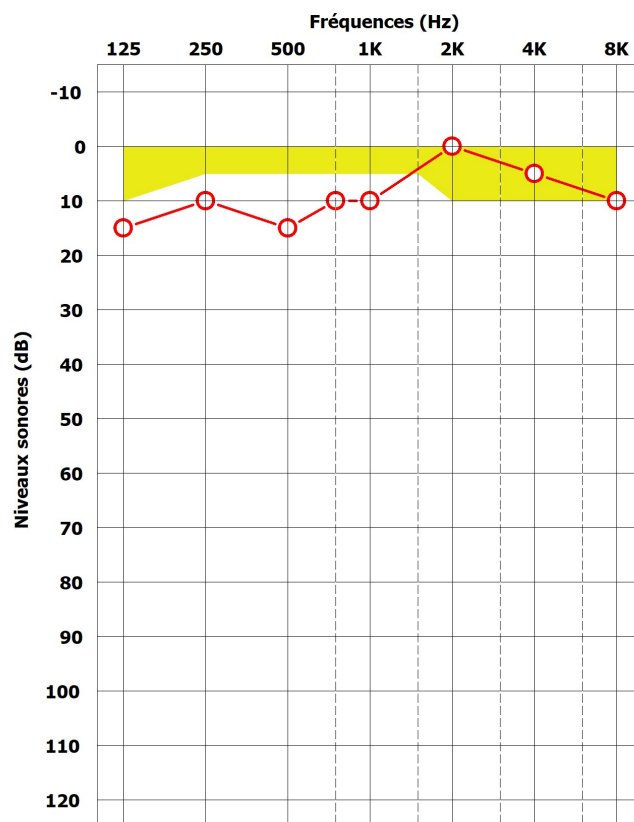

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	20	20	20	15		10		10		20
CA Droit	15	10	15	10	10		0		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes