

MEDVIE


Date du test: 24/02/2024 13:12:31

Durée: 6mn 04s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA MORY
Date de naissance	01/03/1995
Age	28
Société	COVEC
ID	24022413100967136

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

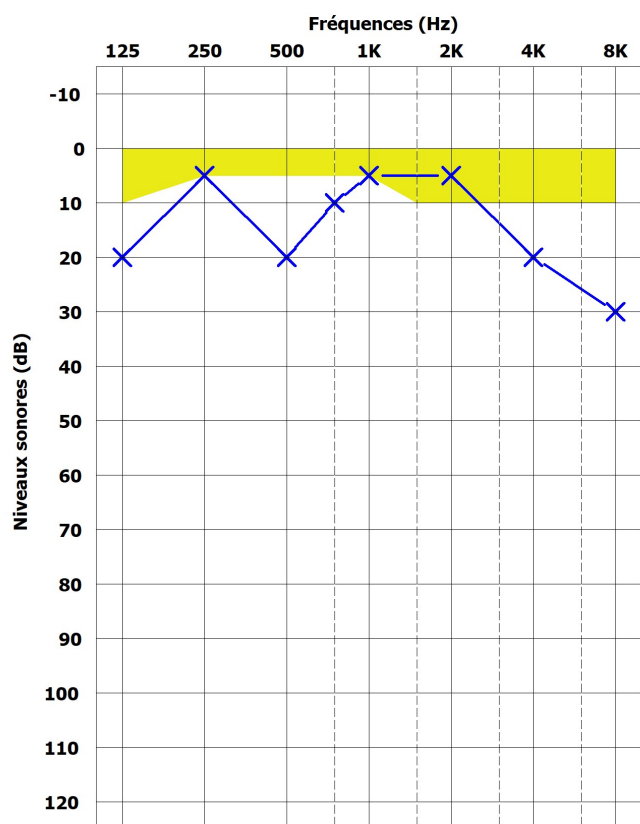

Oreille Gauche

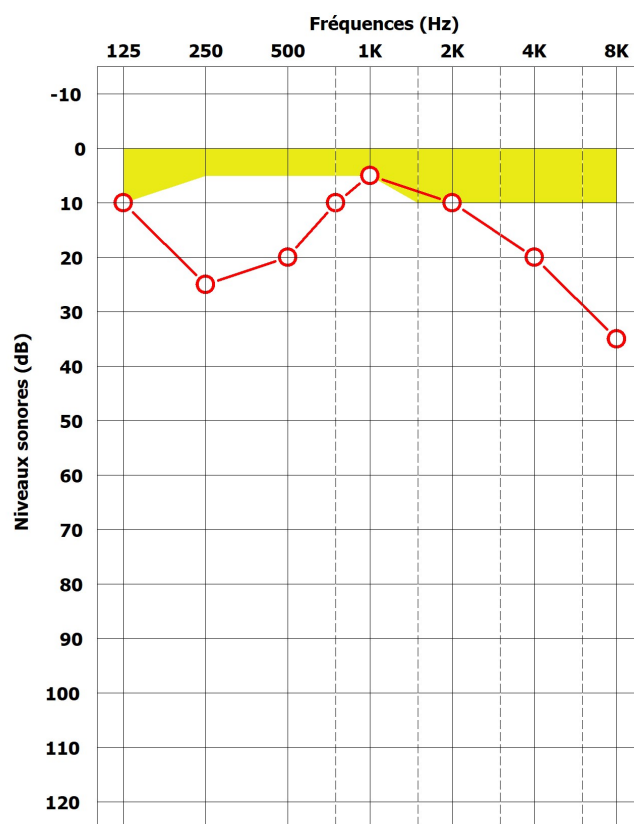

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	5	20	10	5		5		20		30
CA Droit	10	25	20	10	5		10		20		35

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes