


MEDVIE


Date du test: 11/03/2024 14:54:47
Durée: 5mn 04s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KEÏTA SUALIHO	
Date de naissance	02/06/1995
Age	28
Société	COVEC
ID	24031114513248216

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

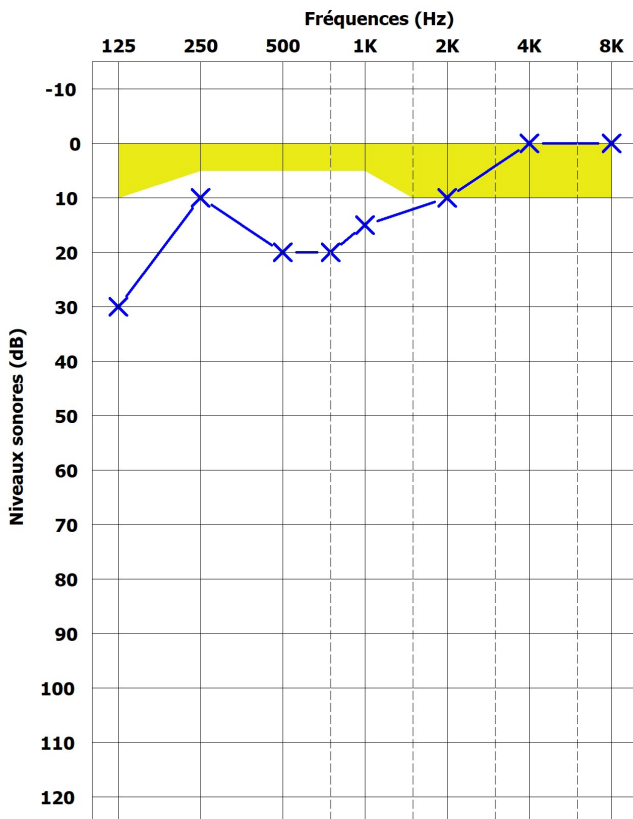

Oreille Gauche

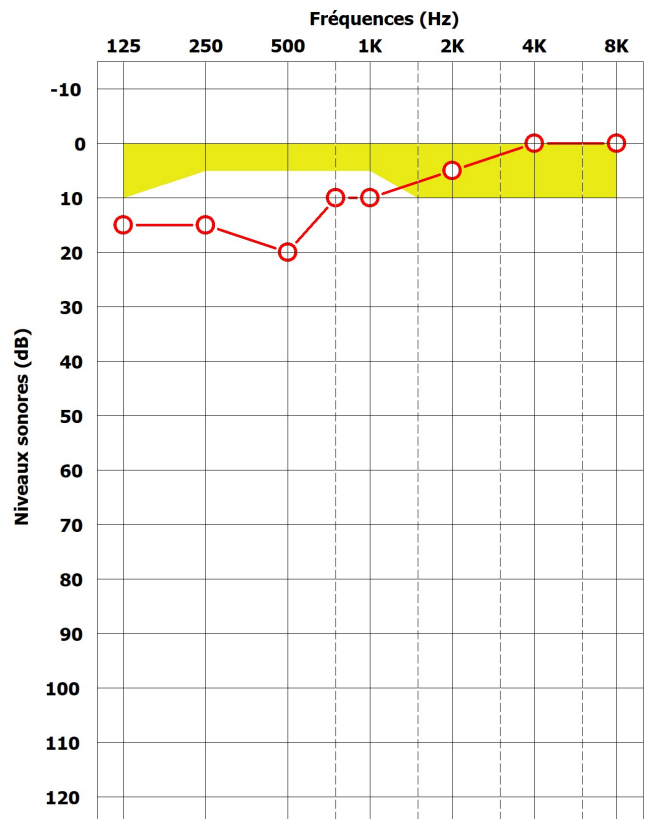

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	10	20	20	15		10		0		0
CA Droit	15	15	20	10	10		5		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes