

MEDVIE


Date du test: 24/02/2024 11:58:13

Durée: 5mn 28s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		FOFANA SIDIKI
Date de naissance	01/01/1993	
Age	31	
Société	COVEC	
ID	24022411535904811	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

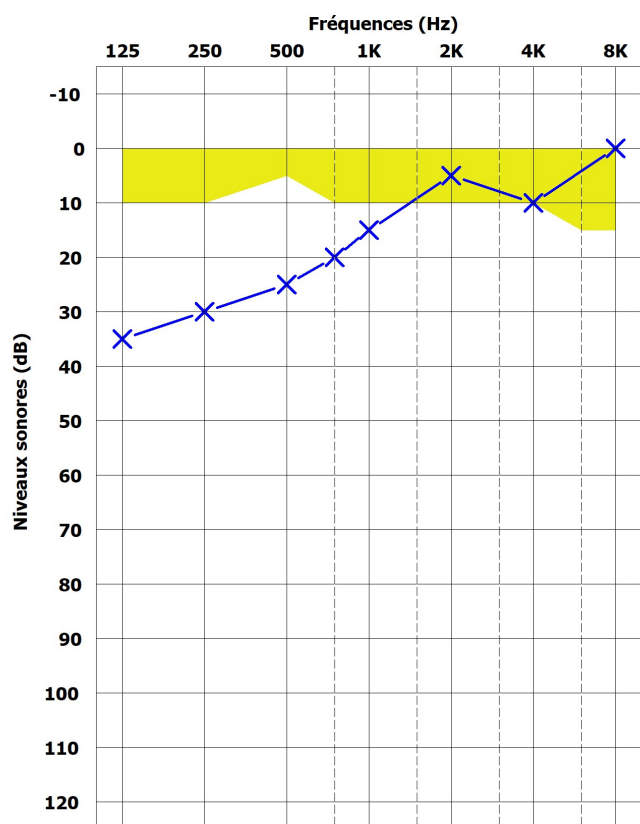

Oreille Gauche

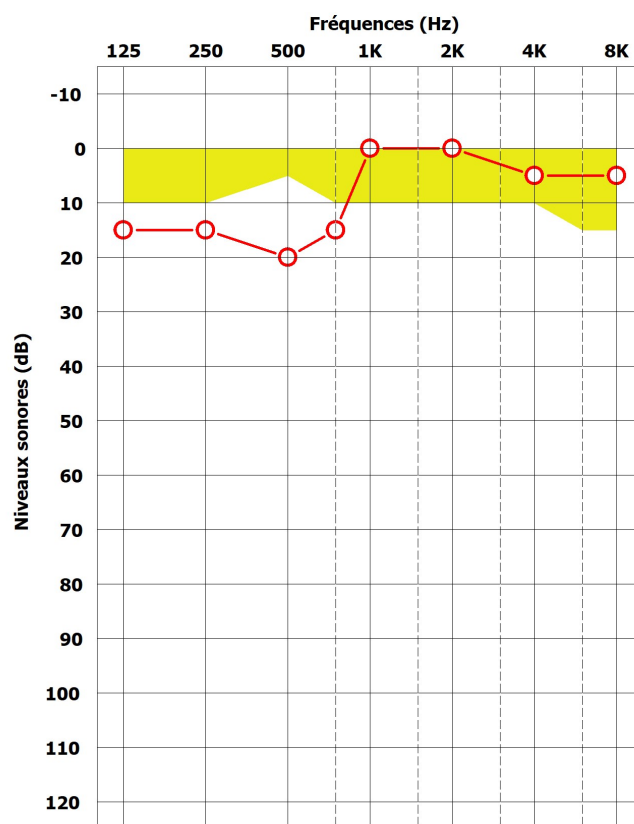

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	30	25	20	15		5		10		0
CA Droit	15	15	20	15	0		0		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes