


MEDVIE


Date du test: 19/02/2024 10:29:29
Durée: 10mn 10s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SOUMAORO LANCINE	
Date de naissance	01/07/1978
Age	45
Société	COVEC
ID	24021910260311911

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

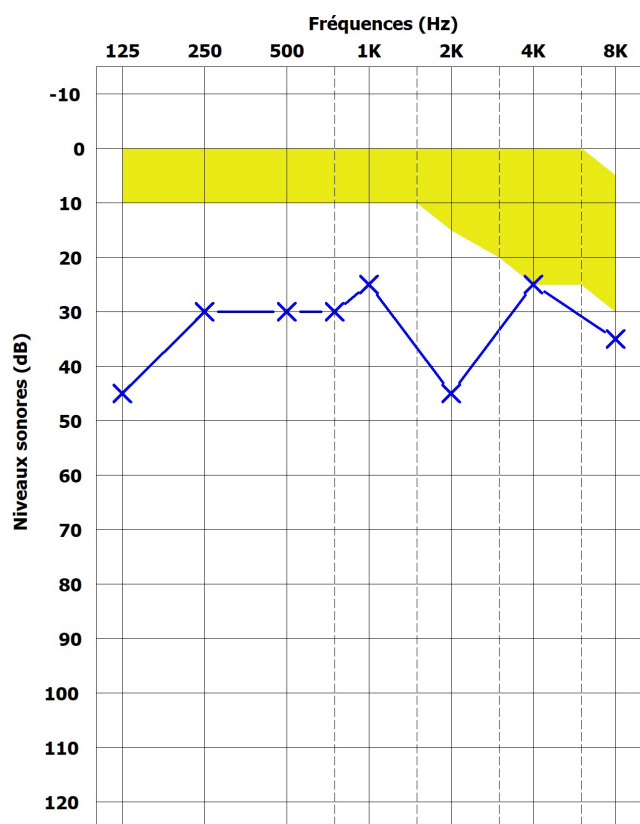

Oreille Gauche

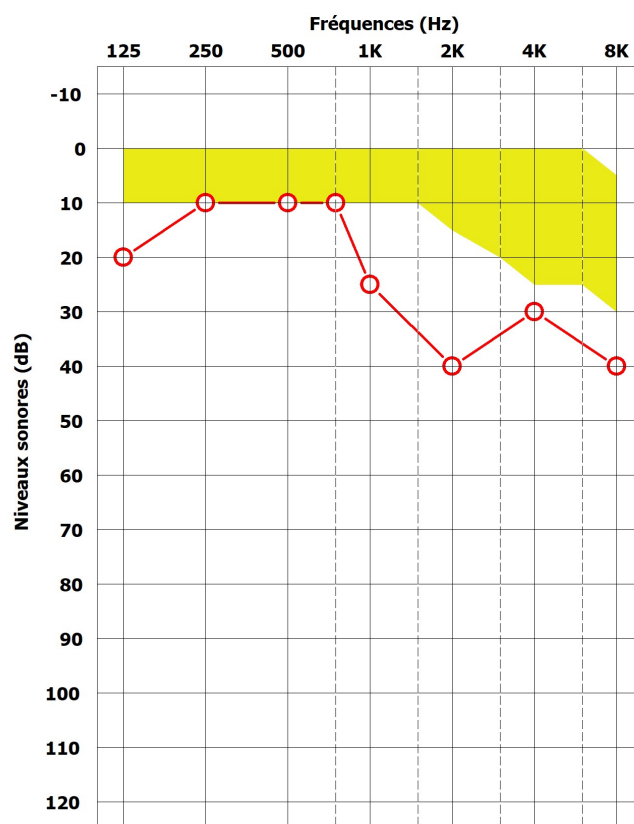

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	45	30	30	30	25		45		25		35
CA Droit	20	10	10	10	25		40		30		40

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	31,3 dB	---
CA Droit	26,3 dB	---

Notes