


MEDVIE


Date du test: 24/02/2024 19:15:27
Durée: 2mn 51s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	BANGOURA YAMOUSSA
Date de naissance	01/07/1978
Age	45
Société	COVEC
ID	24022419135176709

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

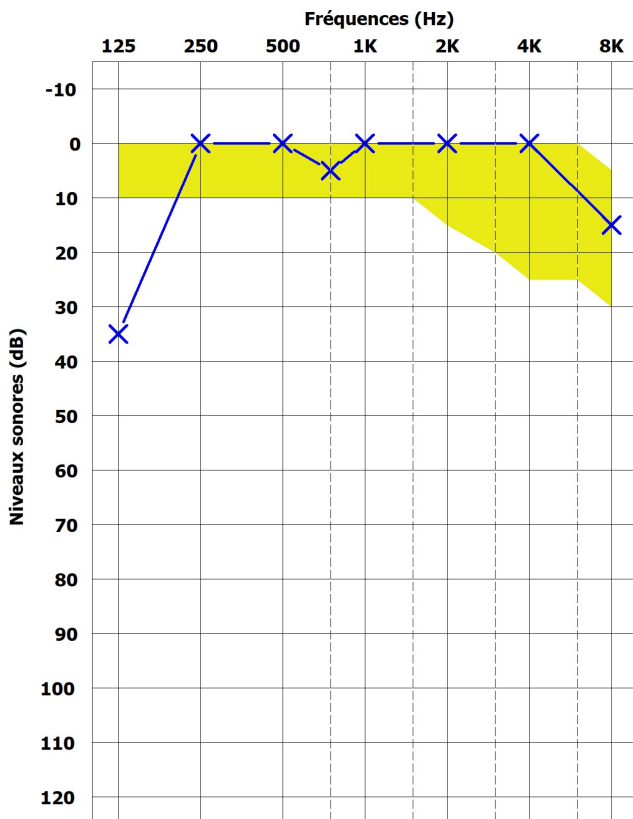

Oreille Gauche

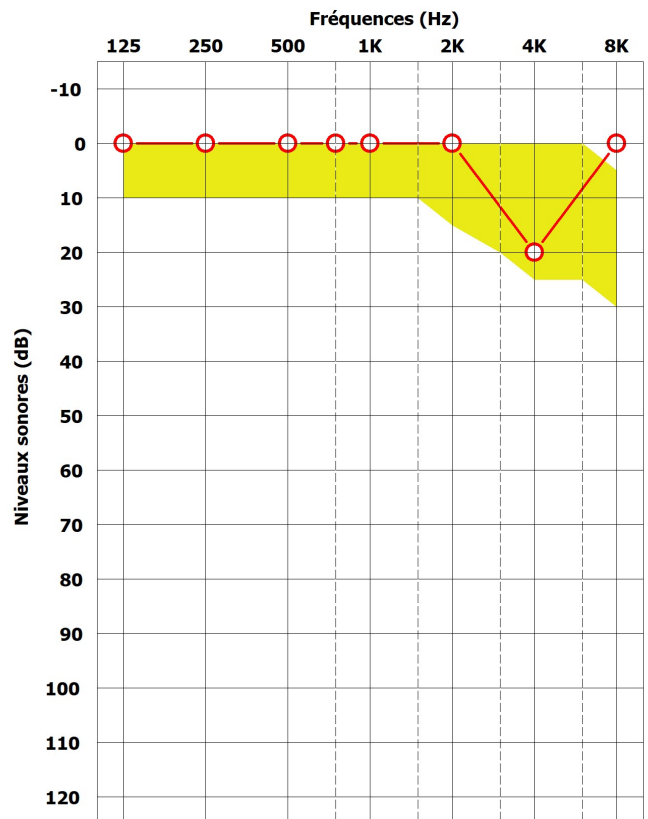

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	0	0	5	0		0		0		15
CA Droit	0	0	0	0	0		0		20		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	0,0 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes