


MEDVIE


Date du test: 21/08/2024 15:37:56
Durée: 3mn 52s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SANOH KALLOU	
Date de naissance	15/02/1994
Age	30
Société	COVEC
ID	24082115360271237

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

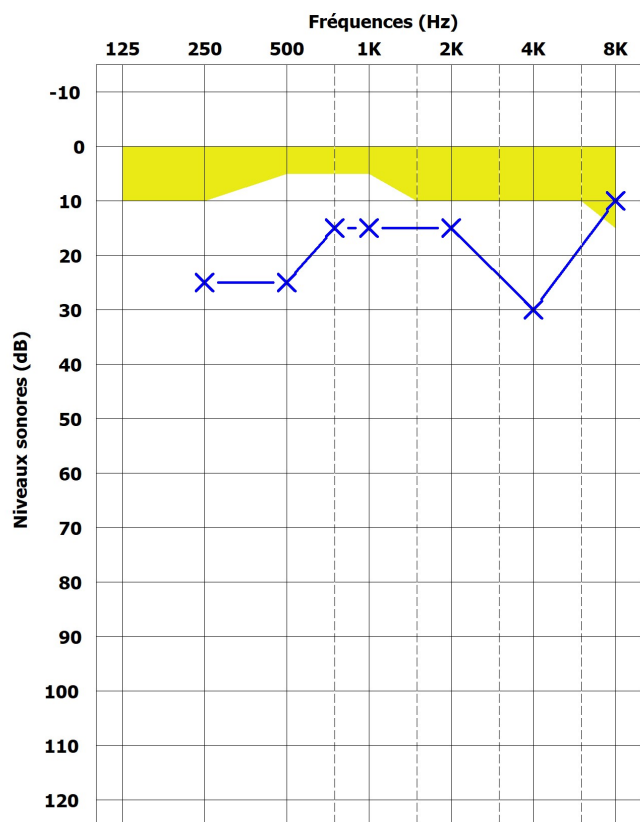

Oreille Gauche

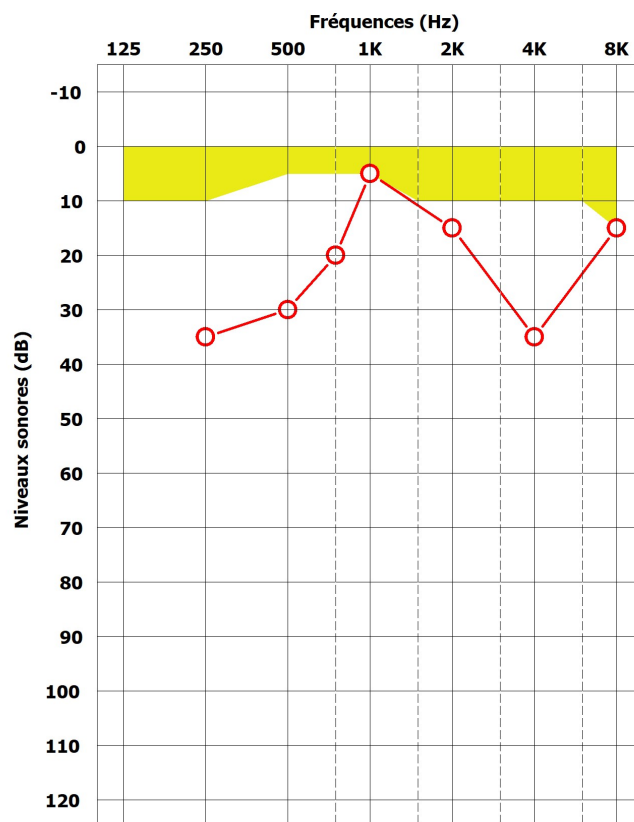

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	15	15		15		30		10
CA Droit		35	30	20	5		15		35		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes