

MEDVIE


Date du test: 24/02/2024 12:39:55

Durée: 7mn 06s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		SAGNO DAVID
Date de naissance	01/01/1973	
Age	51	
Société	COVEC	
ID	24022412354238727	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

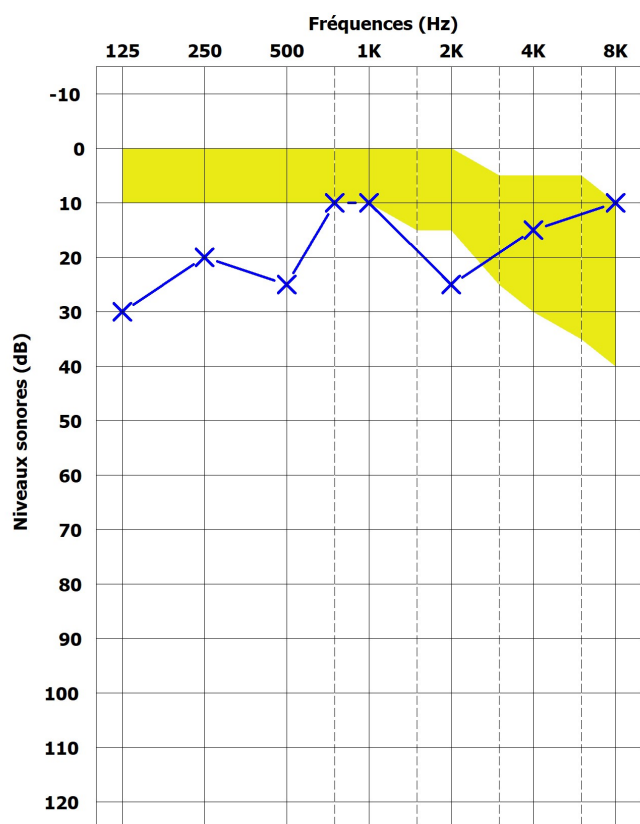

Oreille Gauche

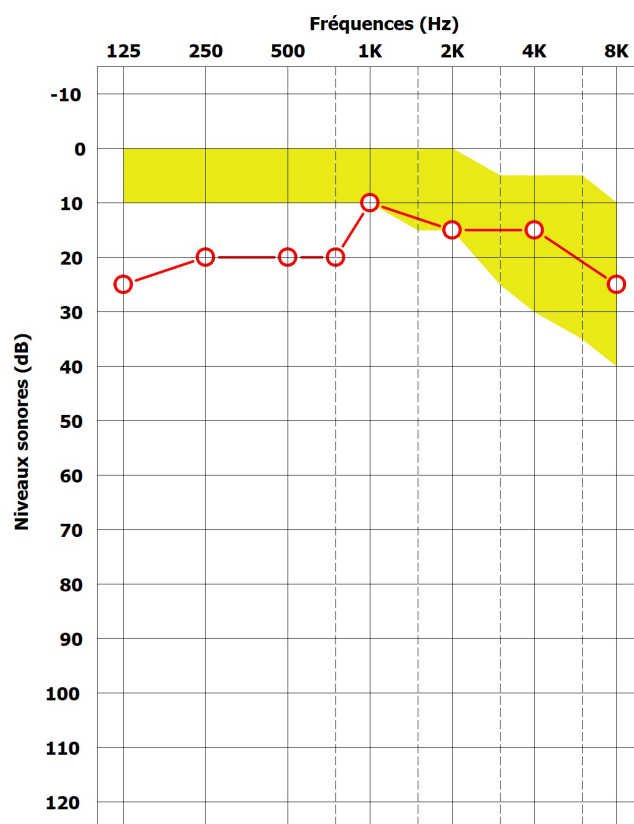

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	20	25	10	10		25		15		10
CA Droit	25	20	20	20	10		15		15		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes