


MEDVIE


Date du test: 19/02/2024 14:58:25
Durée: 6mn 15s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KEITA AMADOU	
Date de naissance	01/01/1988
Age	36
Société	COVEC
ID	24021914560232733

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

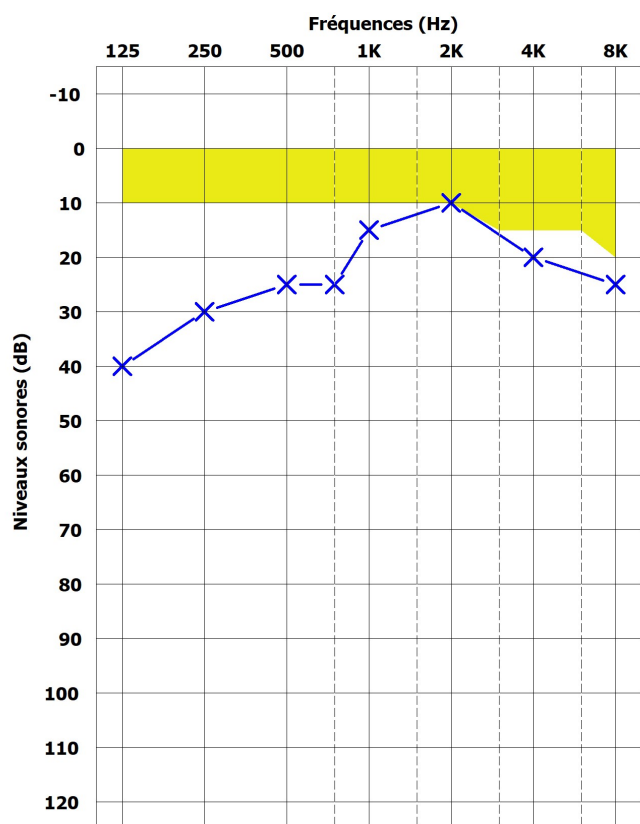

Oreille Gauche

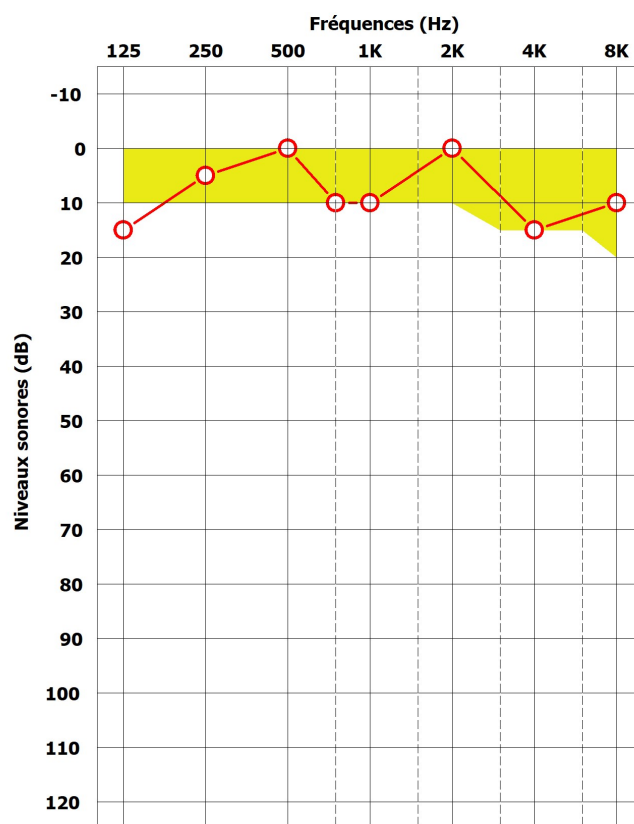

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	40	30	25	25	15		10		20		25
CA Droit	15	5	0	10	10		0		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes