

MEDVIE


Date du test: 21/08/2024 14:09:17

Durée: 4mn 05s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KONATE MAMADOU
Date de naissance	01/01/1983
Age	41
Société	COVEC
ID	24082114062380874

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

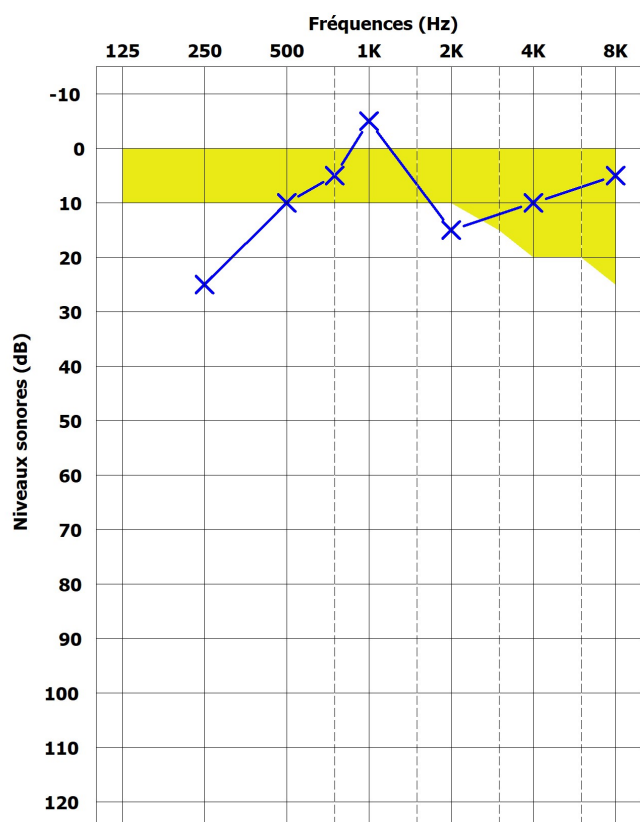

Oreille Gauche

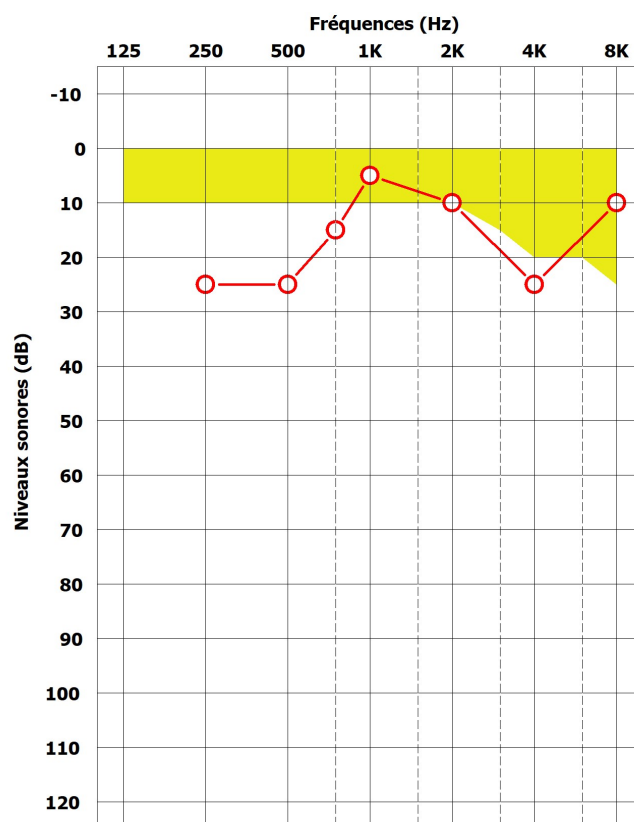

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	10	5	-5		15		10		5
CA Droit		25	25	15	5		10		25		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes