


MEDVIE


Date du test: 05/07/2024 12:03:09
Durée: 4mn 26s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
WAGUE MOHAMED SARO	
Date de naissance	05/03/1985
Age	39
Société	COVEC
ID	24070512002640477

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

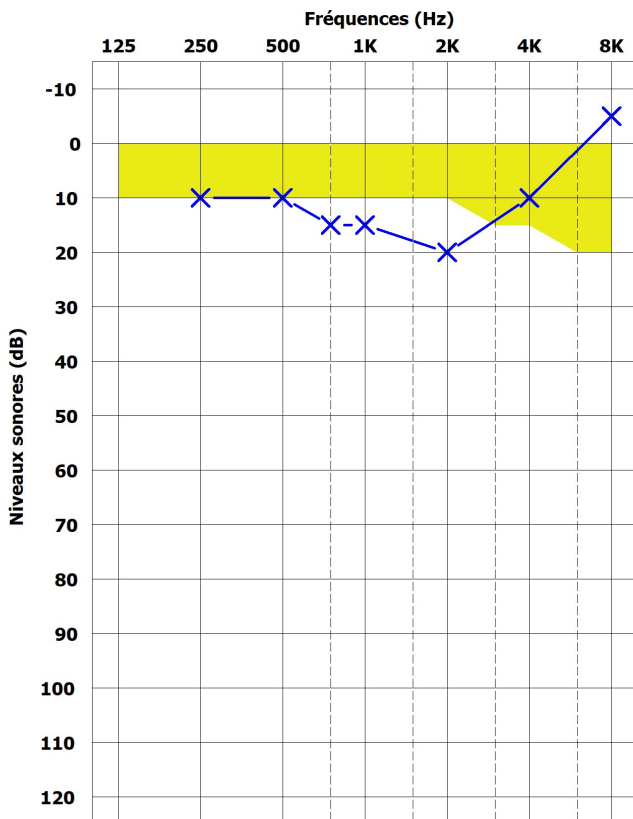

Oreille Gauche

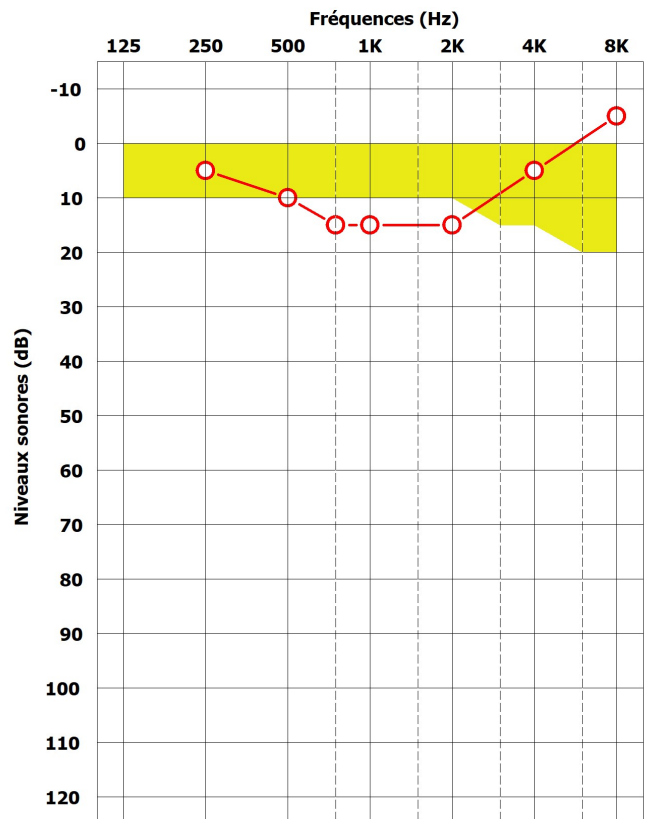

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	15	15		20		10		-5
CA Droit		5	10	15	15		15		5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes