

MEDVIE


Date du test: 11/03/2024 09:04:50

Durée: 6mn 06s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BERETE KERIFALA	
Date de naissance	01/01/1976
Age	48
Société	COVEC
ID	24031108484153726

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

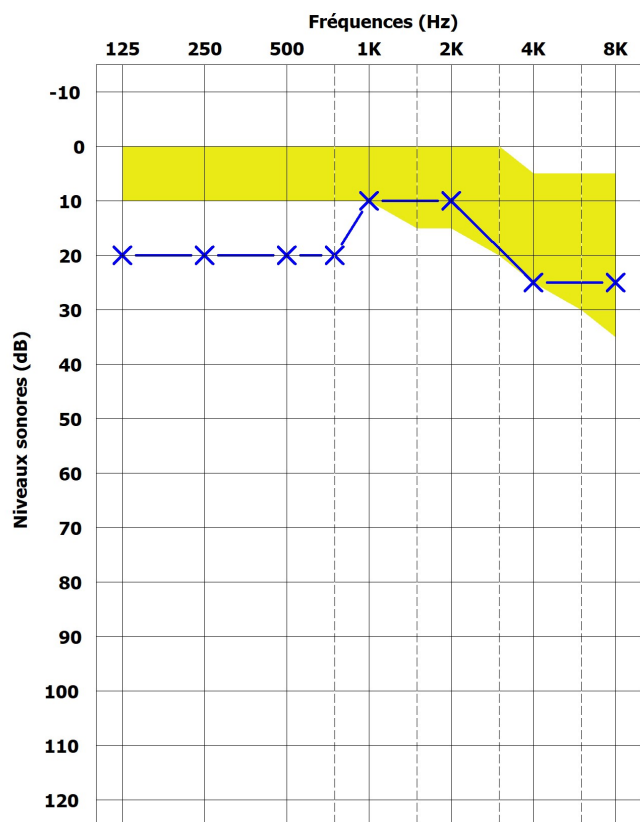

Oreille Gauche

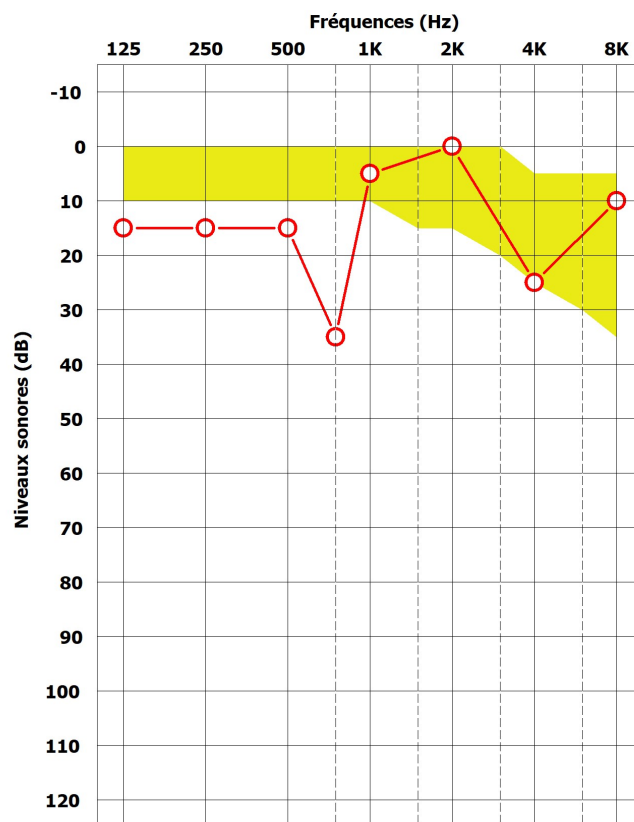

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	20	20	10		10		25		25
CA Droit	15	15	15	35	5		0		25		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes