


Données Patient		KEITA OUSMANE
Date de naissance	01/01/1998	
Age	26	
Société	COVEC/280	
ID	24050615215043424	


MEDVIE

Date du test: 06/05/2024 15:24:46  
 Durée: 7mn 00s  
 Type test: Auto  
 Normal  
 Continu  
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

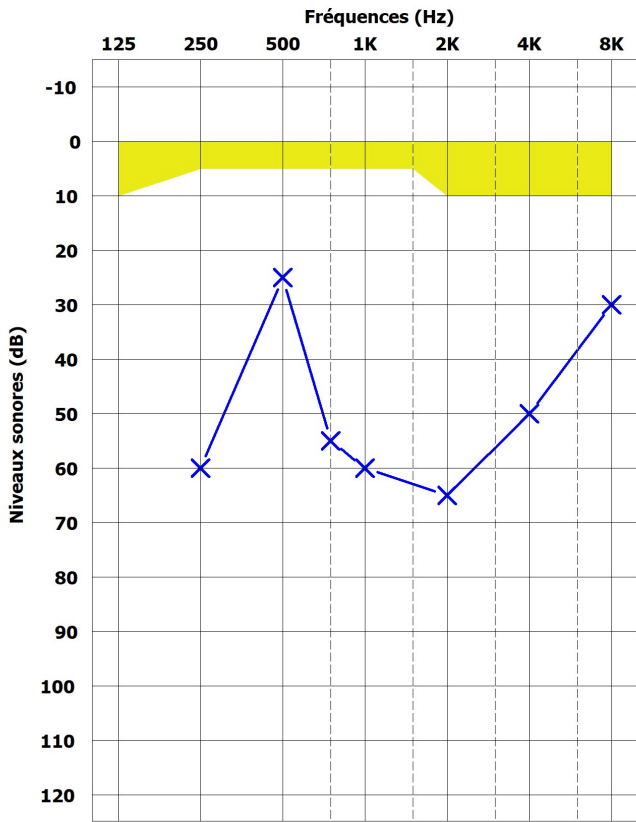

Oreille Gauche

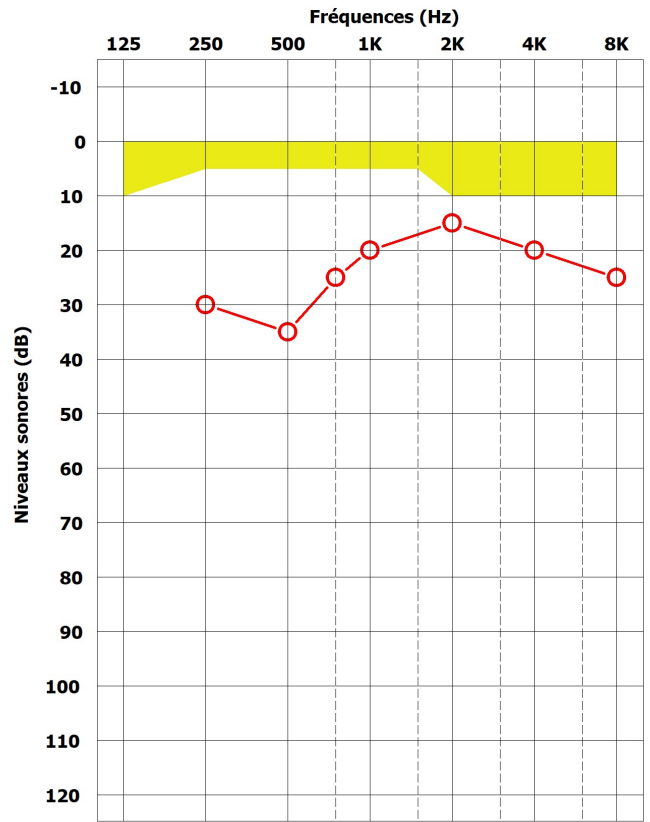

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		60	25	55	60		65		50		30
CA Droit		30	35	25	20		15		20		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	50,0 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes