



Données Patient		DIAKITE BANGALY
Date de naissance	01/01/2004	
Age	20	
Société	CR18	
ID	24051009234043751	

Date du test: 10/05/2024 09:32:04
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

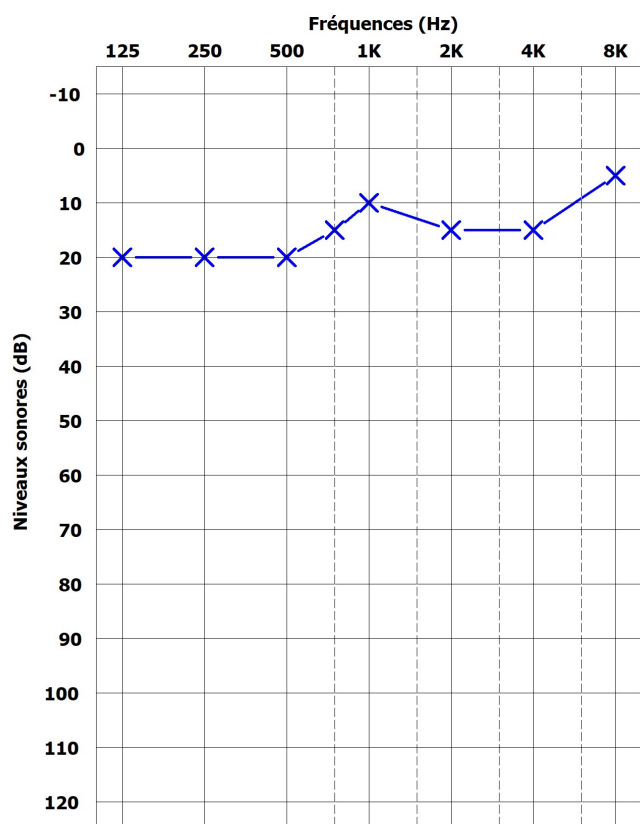

Oreille Gauche

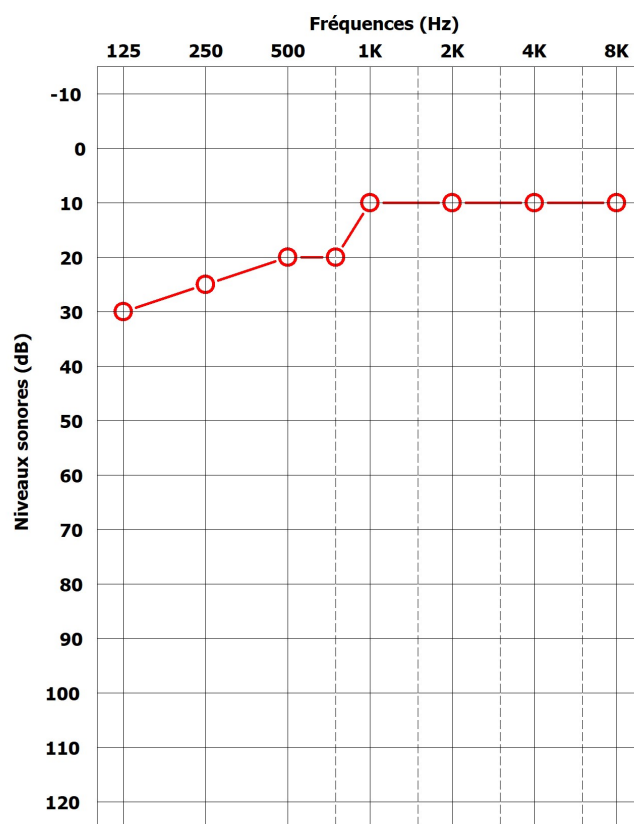

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	20	15	10		15		15		5
CA Droit	30	25	20	20	10		10		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes