

MEDVIE

Date du test: 20/02/2024 14:00:15

Durée: 5mn 50s

Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

Données Patient

**TRAORE SORY**

Date de naissance

07/06/1992

Age

31

Société

COVEC

ID

24022013573653595

Audiomètre

Type:


Audio 820M V2,211

Numéro de série:


2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021

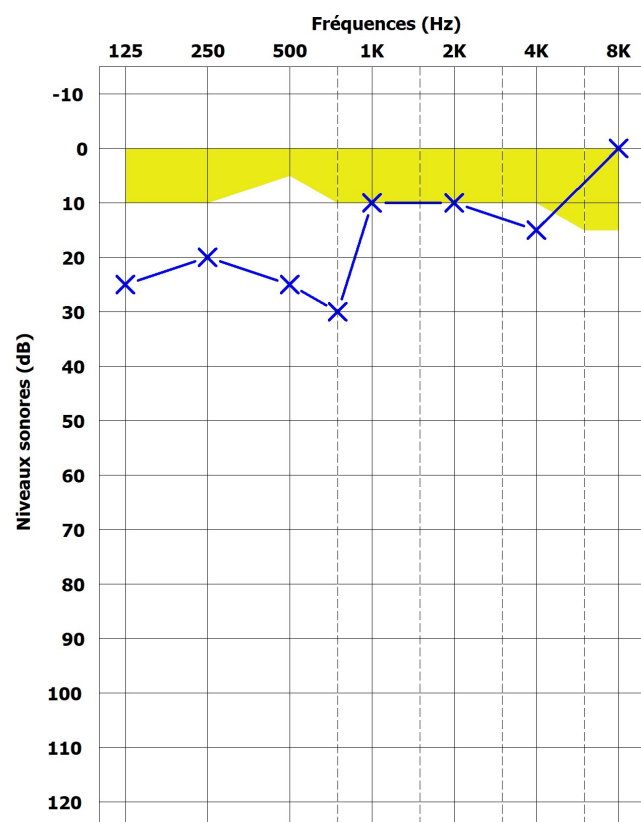

Oreille Gauche

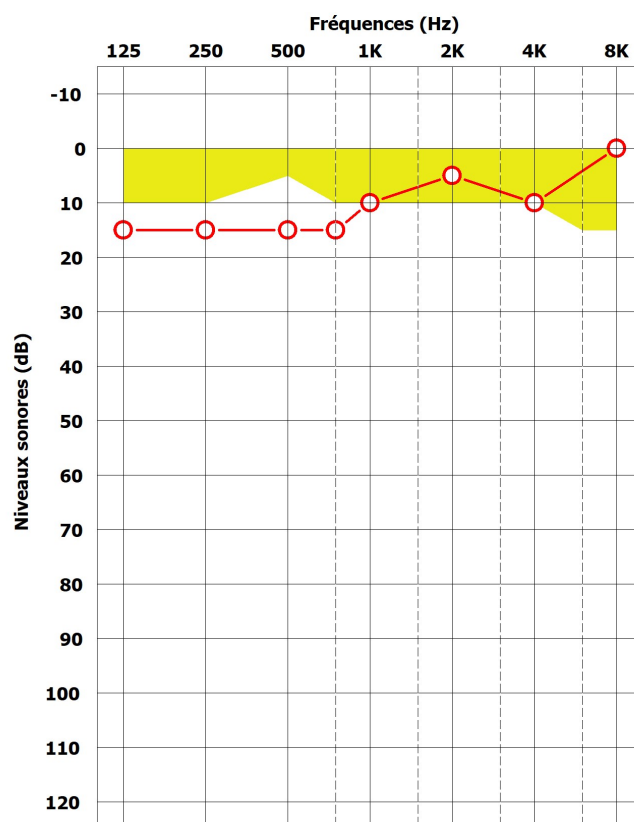

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | 25  | 20  | 25  | 30  | 10 |     | 10 |    | 15 |    | 0  |
| CA Droit  | 15  | 15  | 15  | 15  | 10 |     | 5  |    | 10 |    | 0  |

Calcul de perte

|           | PAM     | IPA |
|-----------|---------|-----|
| CA Gauche | 15,0 dB | --- |
| CA Droit  | 10,0 dB | --- |

Notes