

MEDVIE

Date du test: 13/03/2024 10:55:17

Durée: 9mn 20s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

CAMARA LASSO M

Date de naissance 01/01/1980

Age 44

Société COVEC


ID 24031310520923637

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

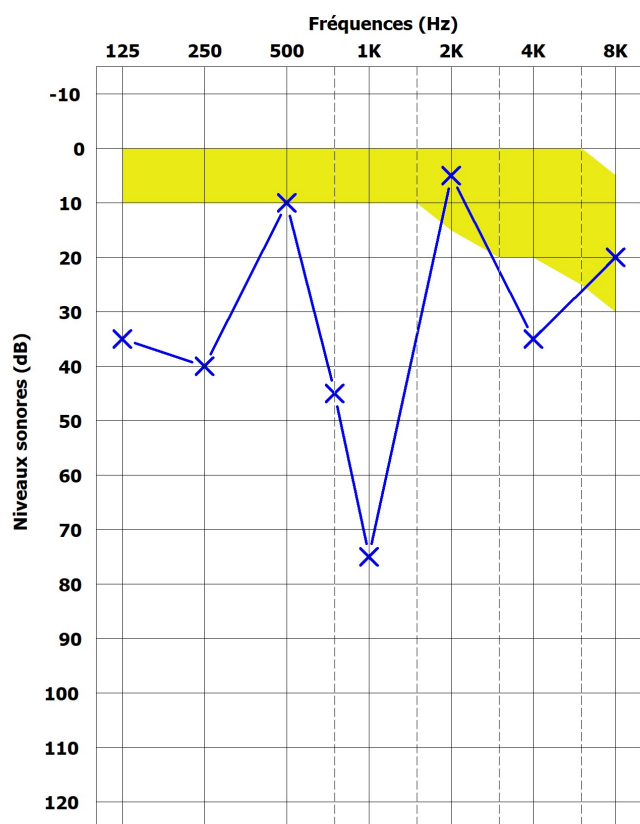

Oreille Gauche

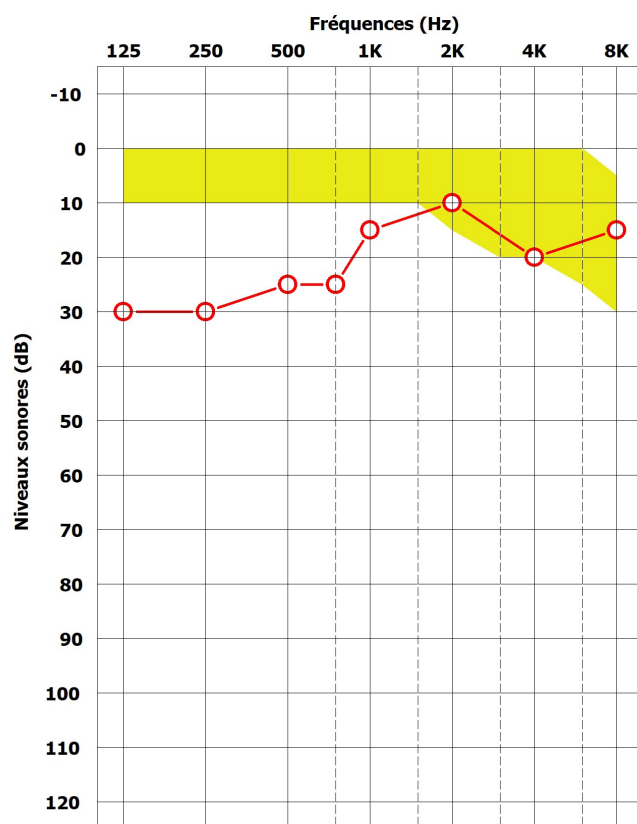

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	40	10	45	75		5		35		20
CA Droit	30	30	25	25	15		10		20		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	31,3 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes