

MEDVIE

Date du test: 20/02/2024 14:46:11

Durée: 8mn 44s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

CONDE KEMO

Date de naissance 01/01/1986

Age 38

Société COVEC


ID 24022014440877000

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

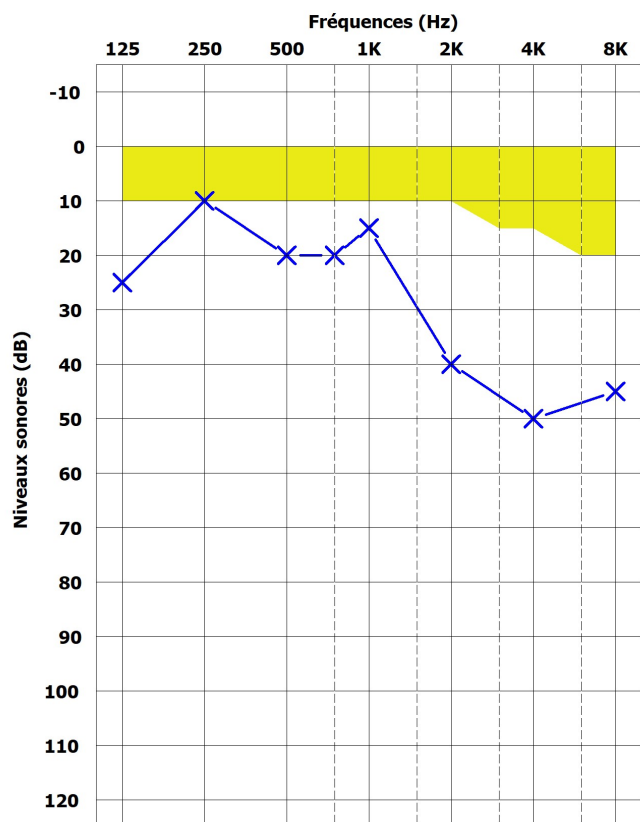

Oreille Gauche

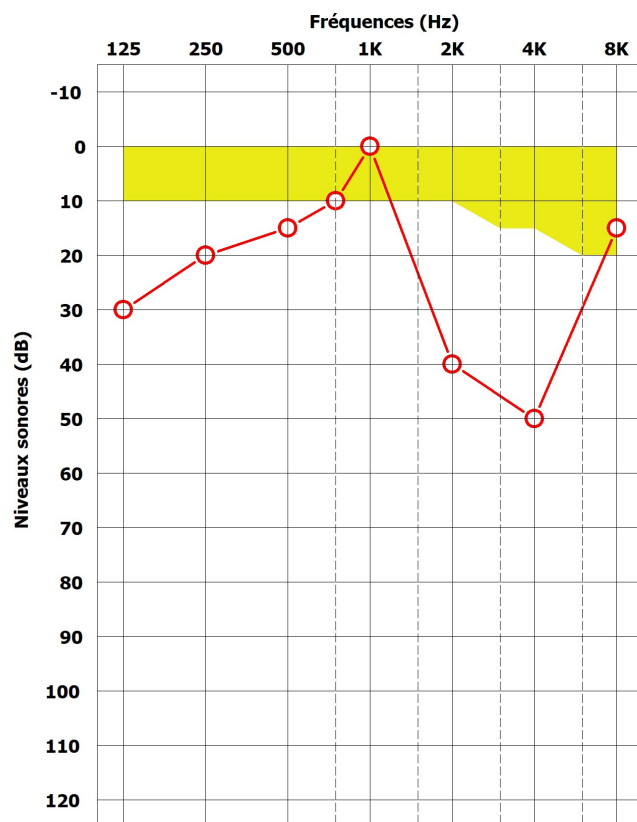

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	10	20	20	15		40		50		45
CA Droit	30	20	15	10	0		40		50		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	31,3 dB	---
CA Droit	26,3 dB	---

Notes