

MEDVIE


Date du test: 22/02/2024 14:28:27

Durée: 5mn 38s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CONDE MAMOUDOU
Date de naissance	05/06/1999
Age	24
Société	COVEC
ID	24022214253855974

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

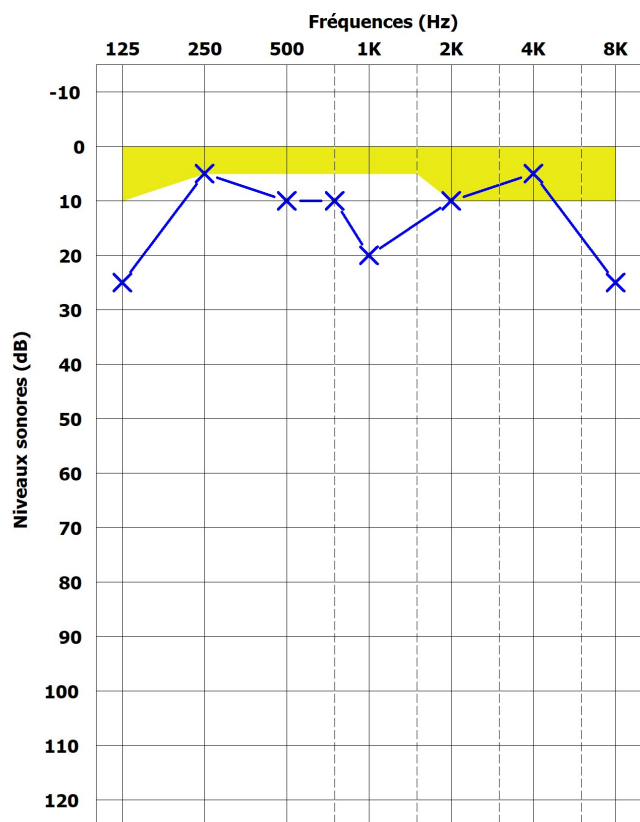

Oreille Gauche

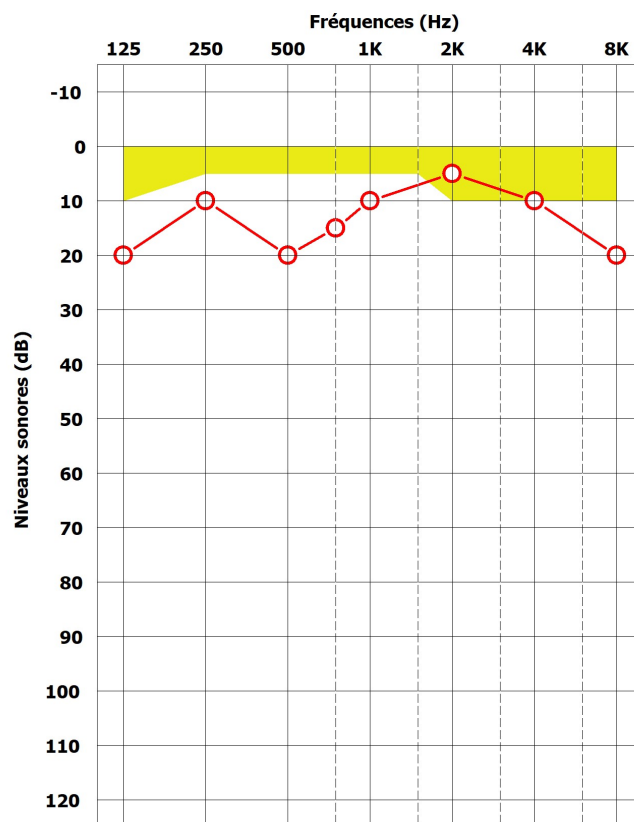

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	5	10	10	20		10		5		25
CA Droit	20	10	20	15	10		5		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes