

MEDVIE


Date du test: 24/02/2024 13:23:08

Durée: 4mn 34s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SANGARE SAYON
Date de naissance	12/01/1980
Age	44
Société	COVEC
ID	24022413192478645

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

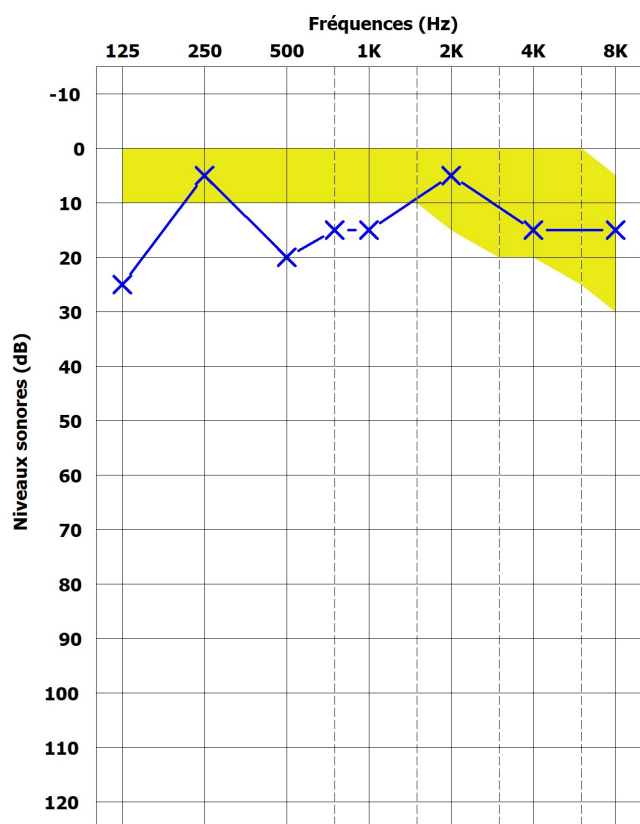

Oreille Gauche

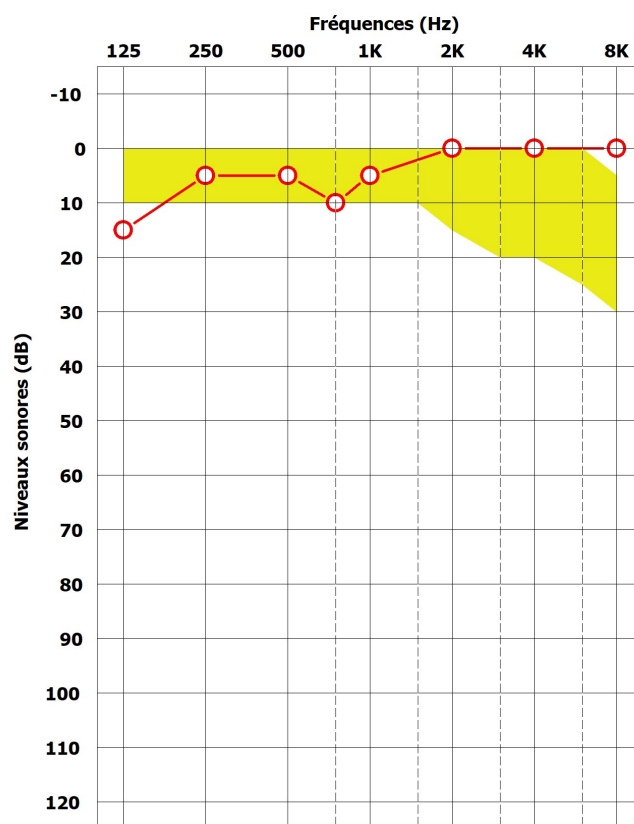

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	5	20	15	15		5		15		15
CA Droit	15	5	5	10	5		0		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes