


MEDVIE


Date du test: 11/03/2024 12:00:29
Durée: 5mn 22s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA MORY
Date de naissance	25/05/1991
Age	32
Société	COVEC
ID	24031111583615272

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

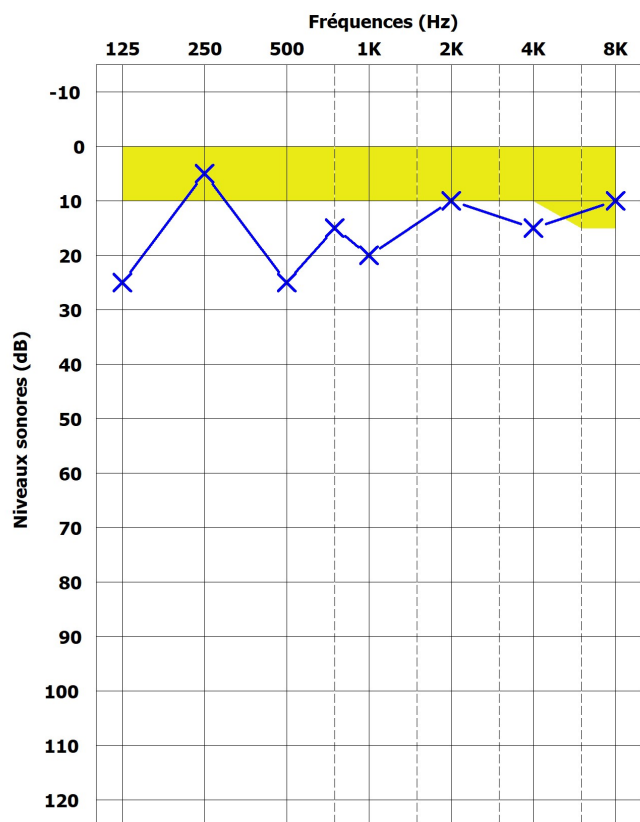

Oreille Gauche

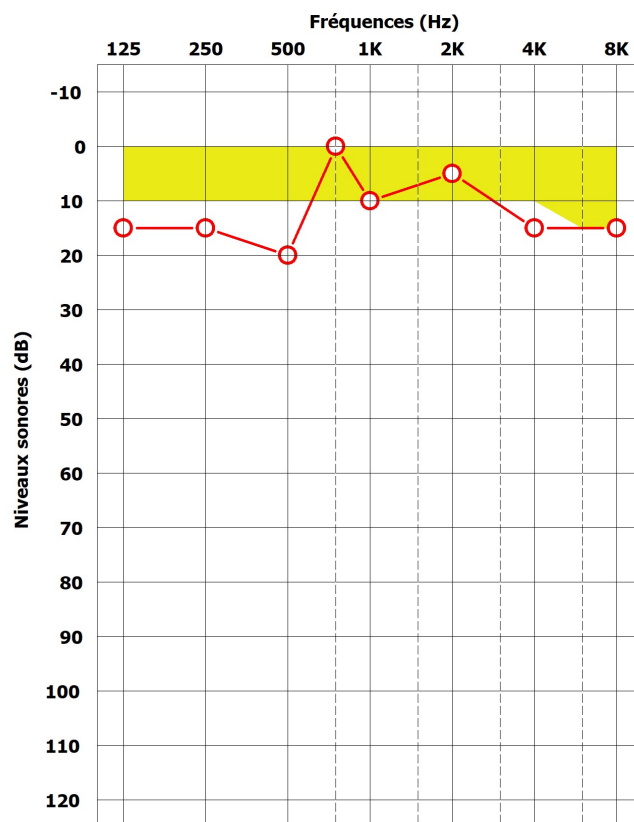

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	5	25	15	20		10		15		10
CA Droit	15	15	20	0	10		5		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes