


MEDVIE


Date du test: 21/08/2024 14:00:43

Durée: 4mn 48s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

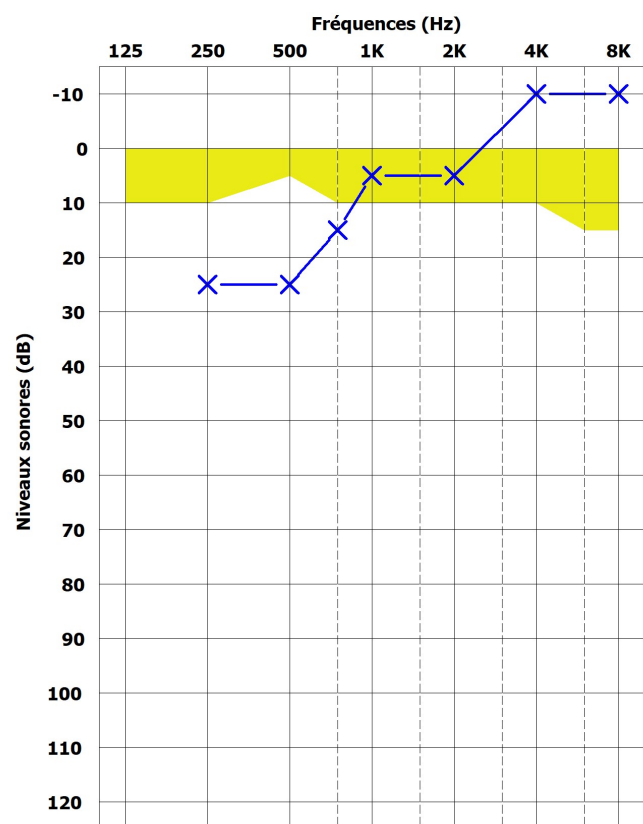

Oreille Gauche

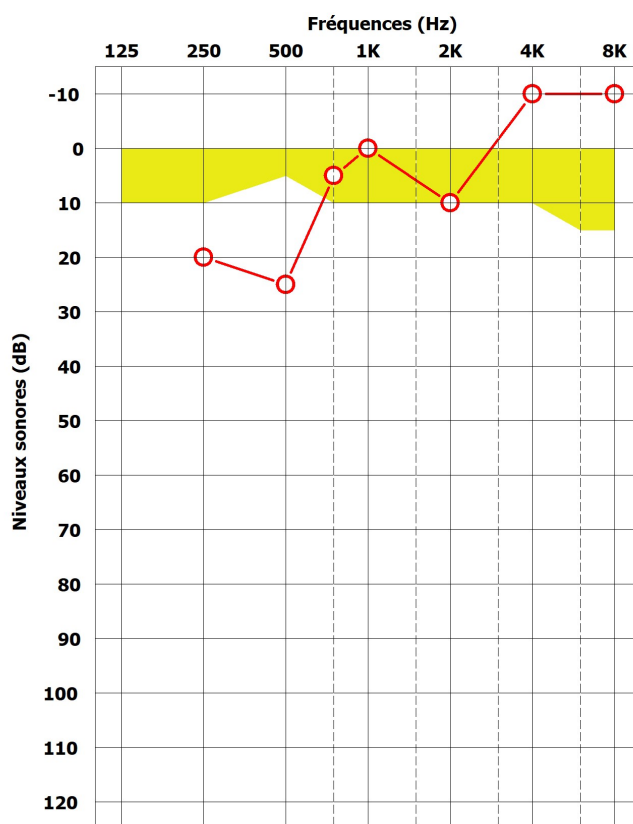

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	15	5		5		-10		-10
CA Droit		20	25	5	0		10		-10		-10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes

Données Patient	KONE N'FALY
Date de naissance	01/06/1993
Age	31
Société	COVEC
ID	24082113584758990

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021