

MEDVIE


Date du test: 23/02/2024 12:18:32

Durée: 5mn 30s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA AMADOU
Date de naissance	27/05/2000
Age	23
Société	COVEC
ID	24022312153372225

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

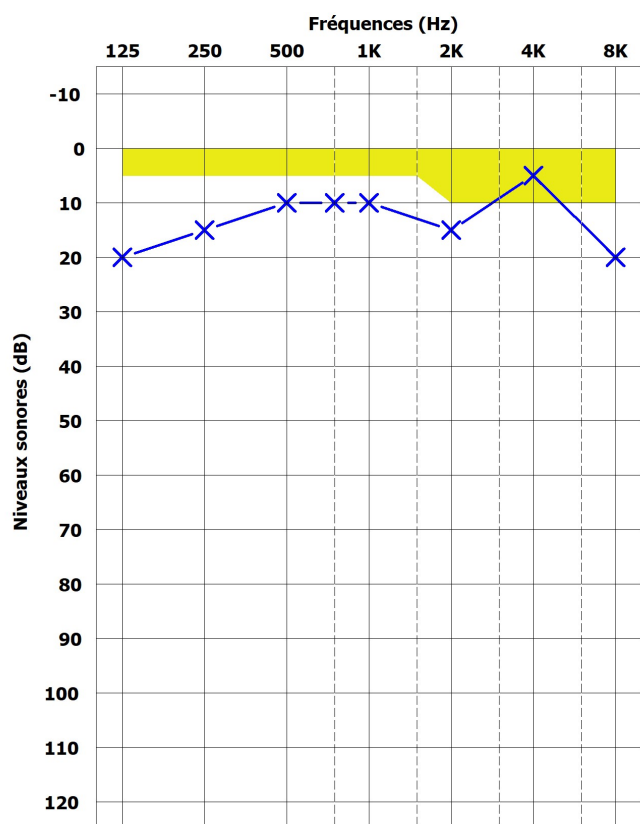

Oreille Gauche

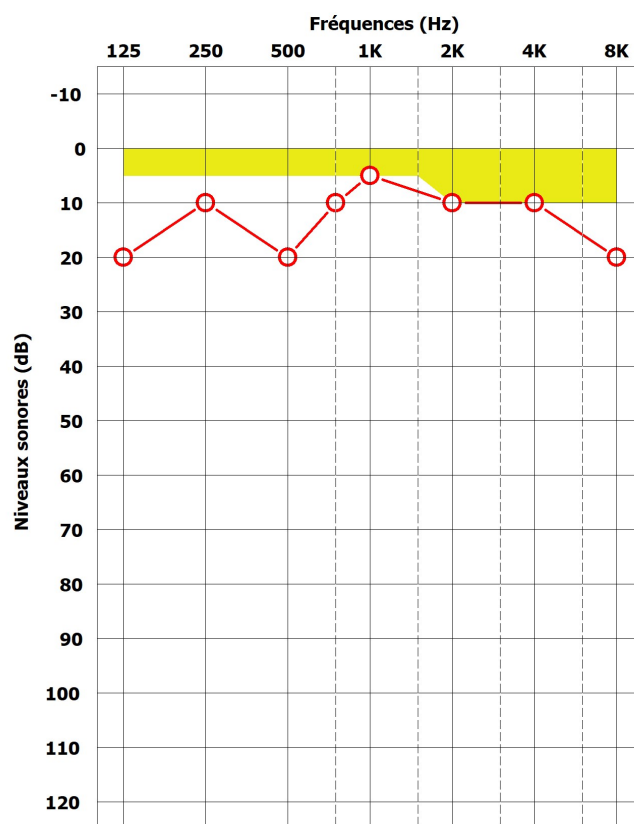

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	10	10	10		15		5		20
CA Droit	20	10	20	10	5		10		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes