

MEDVIE


Date du test: 11/03/2024 12:11:51

Durée: 4mn 34s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	BERETE DAOUDA
Date de naissance	01/01/1981
Age	43
Société	COVEC
ID	24031112073799237

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

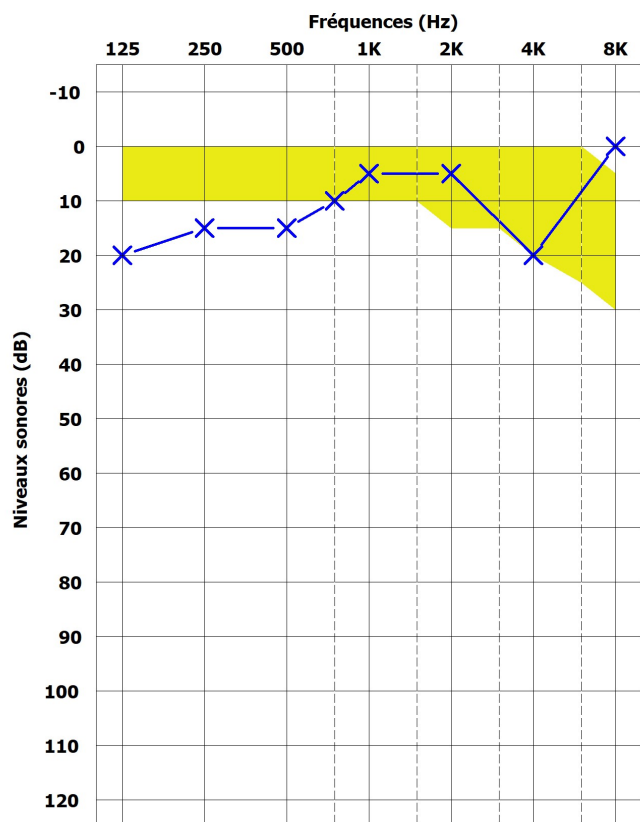

Oreille Gauche

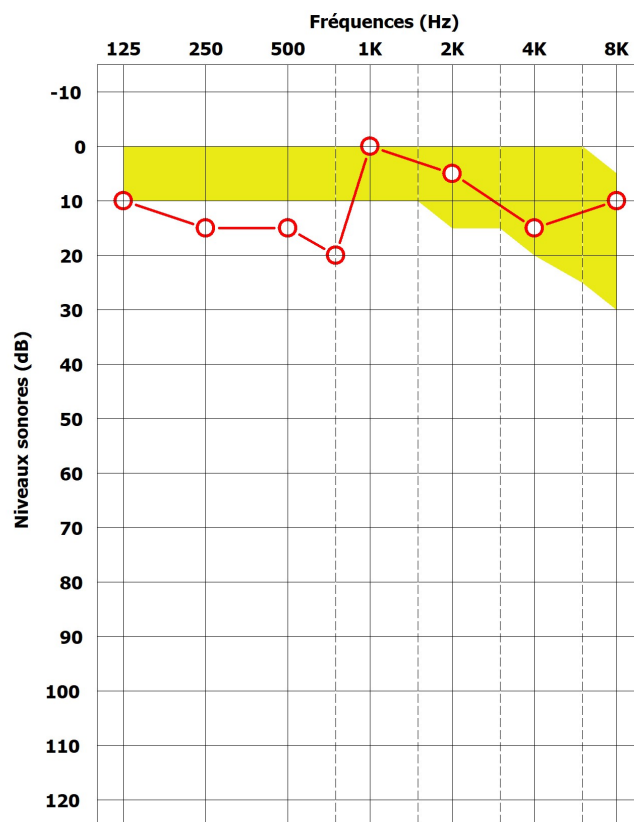

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	15	10	5		5		20		0
CA Droit	10	15	15	20	0		5		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes