

MEDVIE


Date du test: 22/02/2024 09:36:30

Durée: 7mn 15s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DORE SIDIKI	
Date de naissance	01/01/1990
Age	34
Société	COVEC
ID	24022209350268696

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

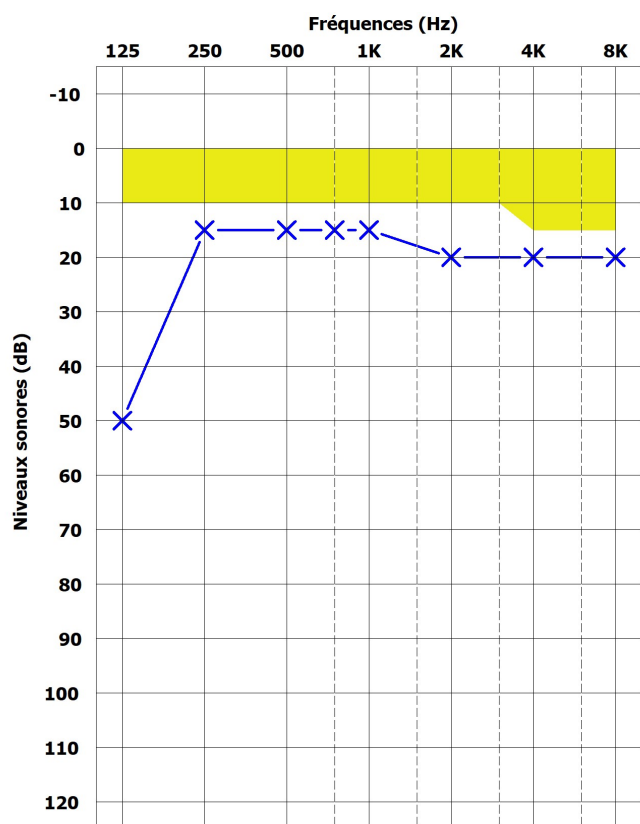

Oreille Gauche

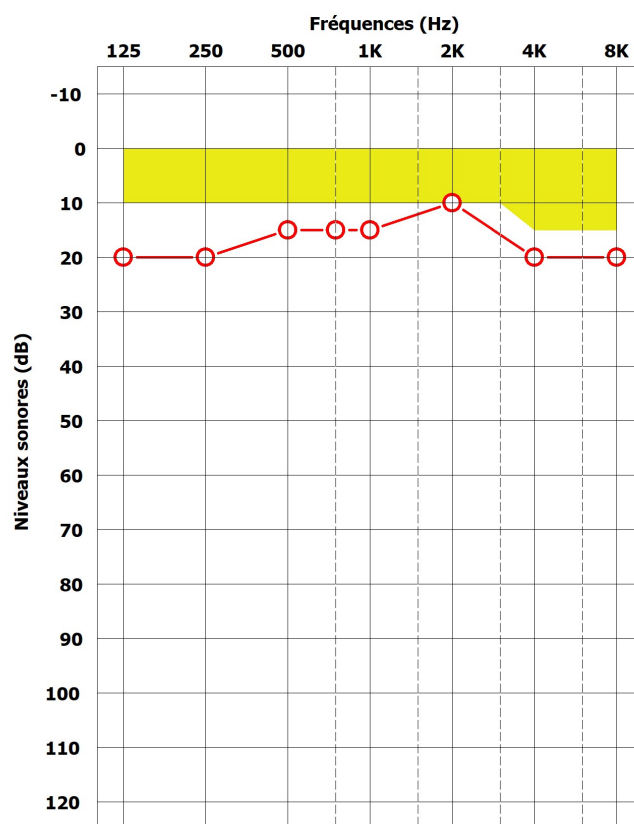

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	50	15	15	15	15		20		20		20
CA Droit	20	20	15	15	15		10		20		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes