

MEDVIE


Date du test: 19/02/2024 10:15:33

Durée: 6mn 05s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	DONWO KABINET
Date de naissance	01/01/1992
Age	32
Société	COVEC
ID	24021910113035161

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

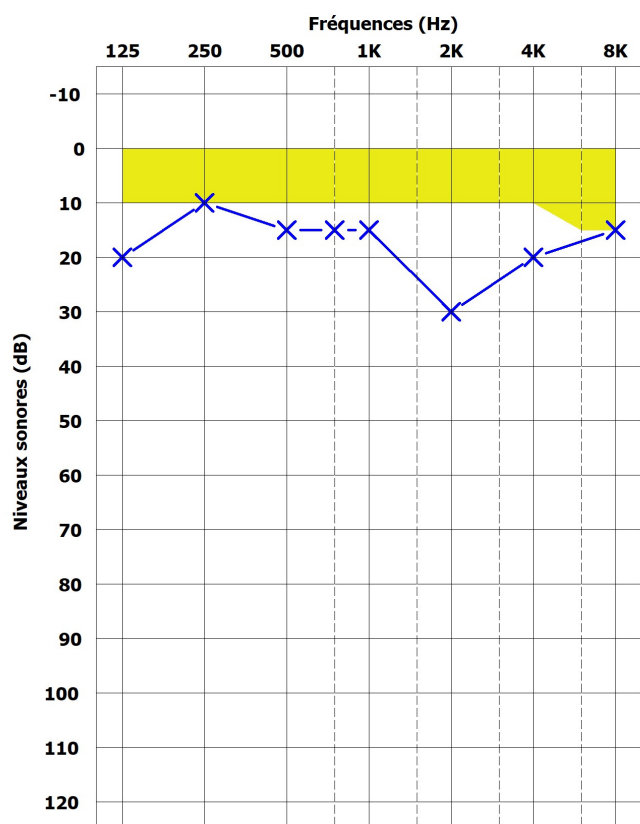

Oreille Gauche

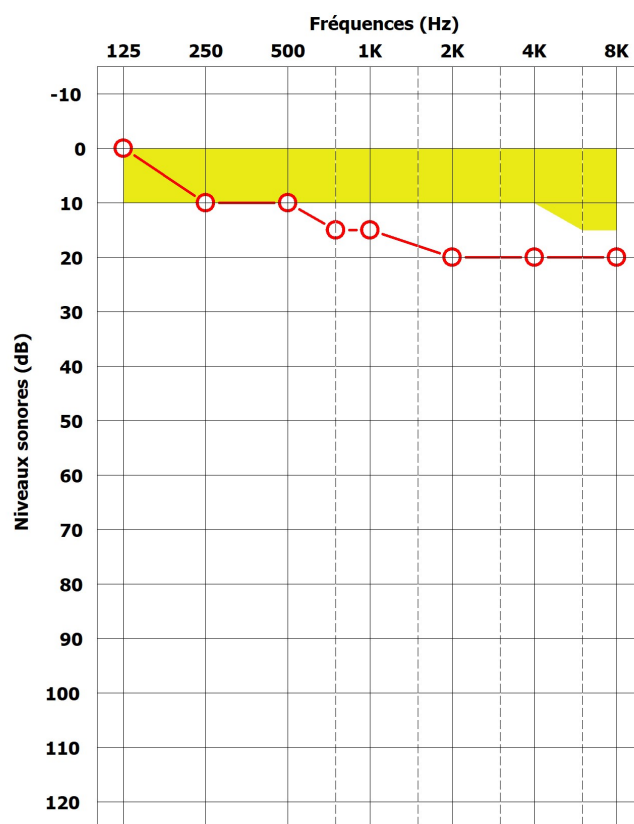

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	10	15	15	15		30		20		15
CA Droit	0	10	10	15	15		20		20		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes