

MEDVIE


Date du test: 19/02/2024 14:07:18

Durée: 4mn 55s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA KEMO	
Date de naissance	01/12/1997
Age	26
Société	COVEC
ID	24021914033236656

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

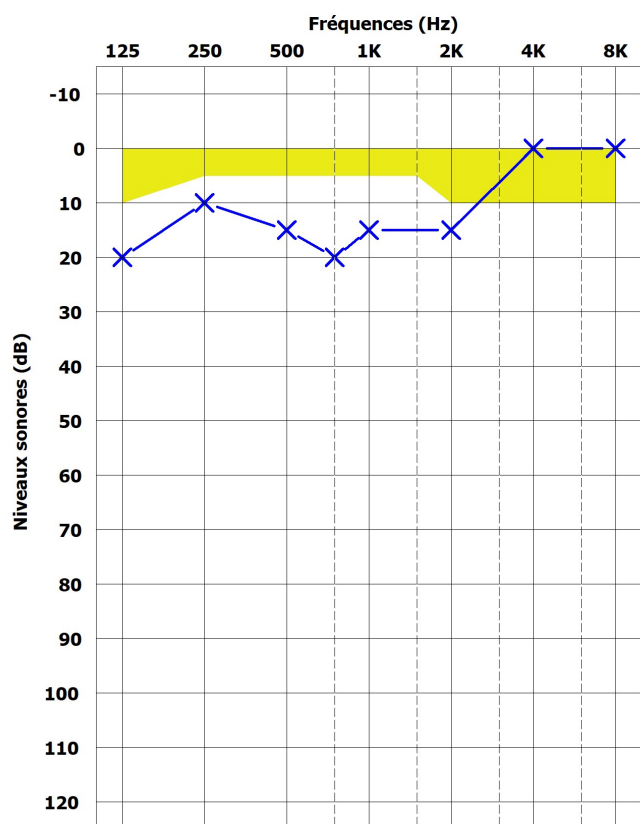

Oreille Gauche

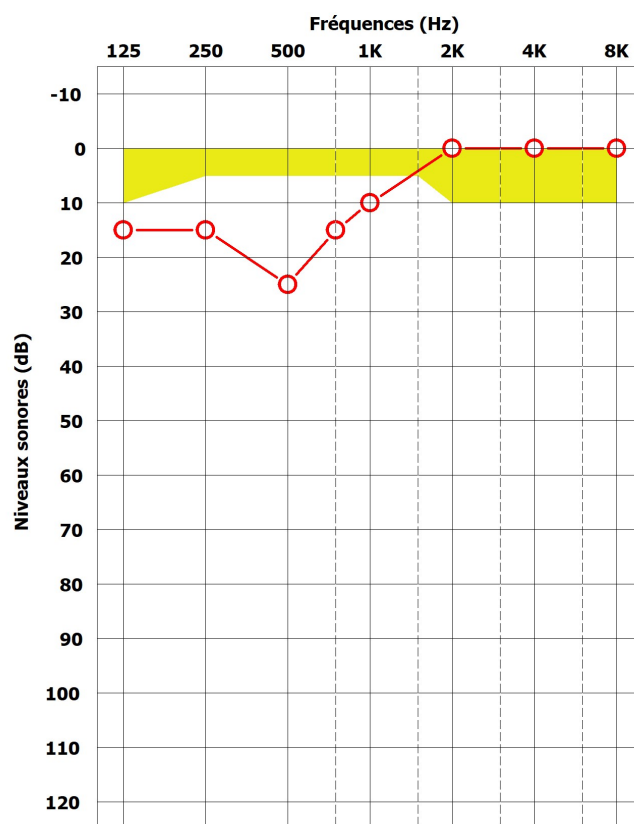

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	10	15	20	15		15		0		0
CA Droit	15	15	25	15	10		0		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes