

MEDVIE


Date du test: 05/10/2024 11:05:15

Durée: 10mn 05s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CAMARA MAMADY
Date de naissance	01/01/1987	
Age	37	
Société	COVEC	
ID	24100511023799698	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

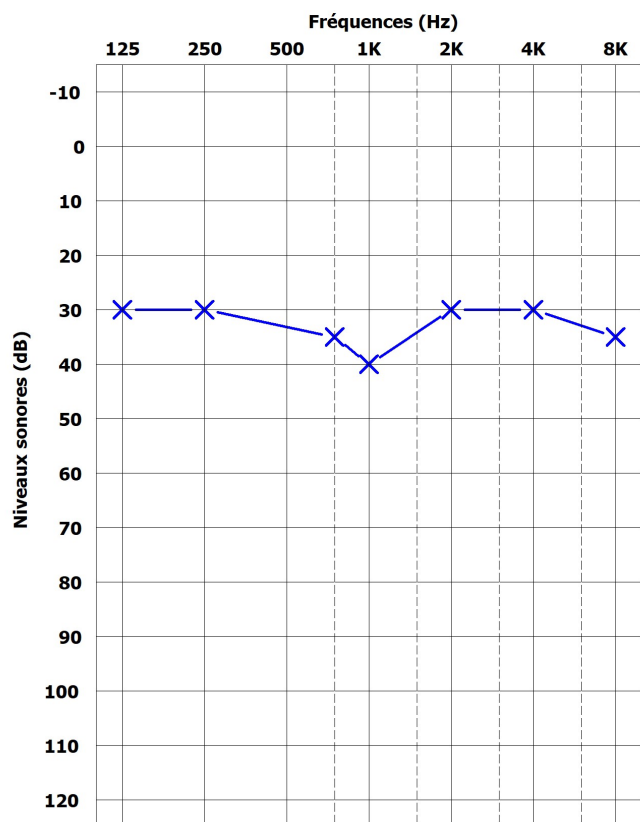

Oreille Gauche

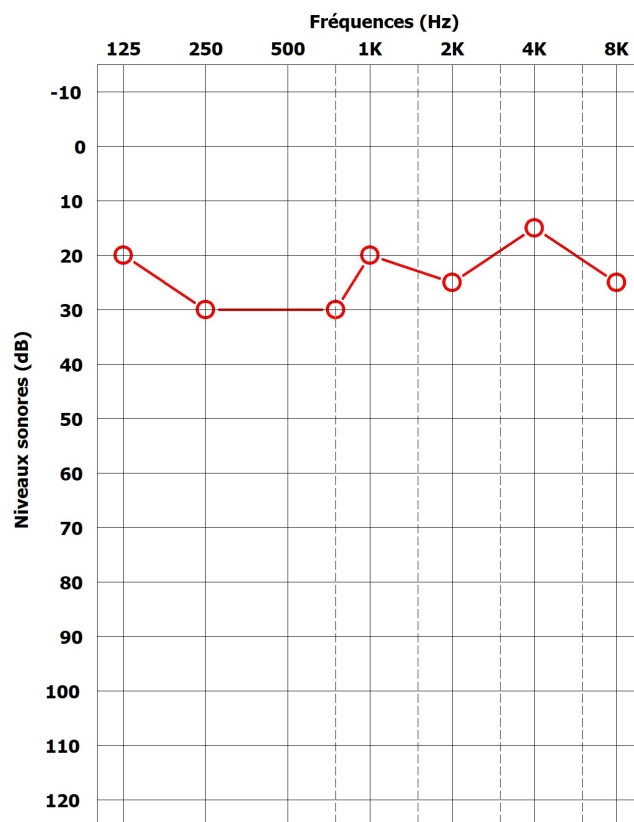

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	30		35	40		30		30		35
CA Droit	20	30		30	20		25		15		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	---	---
CA Droit	---	---

Notes