

MEDVIE

Date du test: 31/05/2024 13:03:01

Durée: 6mn 15s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

CONDE SOUMAILA

Date de naissance 25/01/1990

Age 34

Société MV/BCEIP


ID 24053113003097482

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021

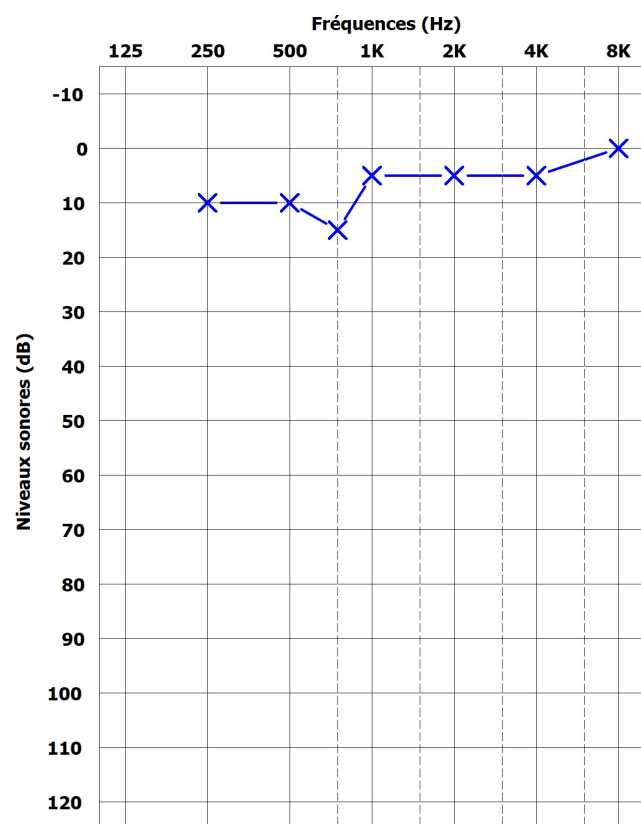

Oreille Gauche

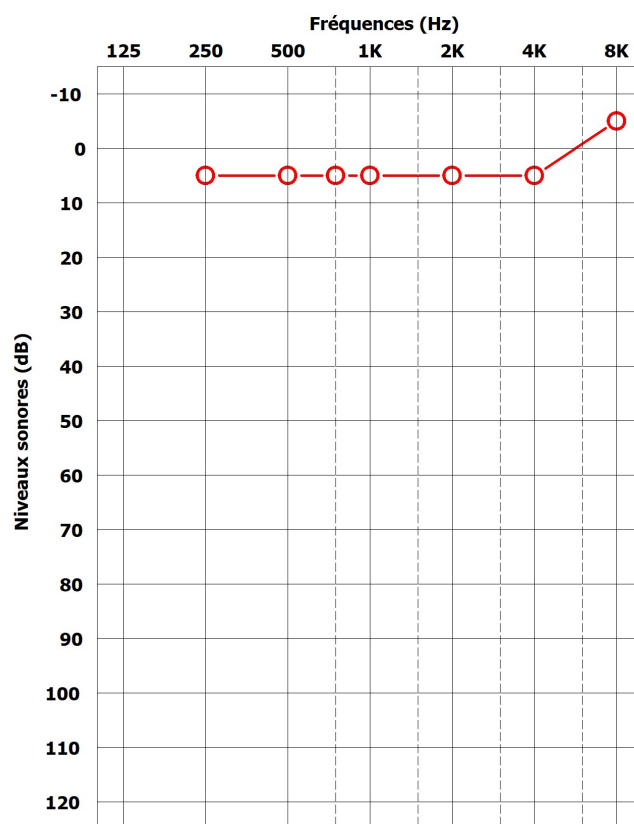

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	15	5		5		5		0
CA Droit		5	5	5	5		5		5		-5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes