

MEDVIE


Date du test: 28/03/2024 14:48:34

Durée: 10mn 18s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	TRAORE MOHAMED
Date de naissance	01/01/1990
Age	34
Société	BCEIP
ID	24032814451407313

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

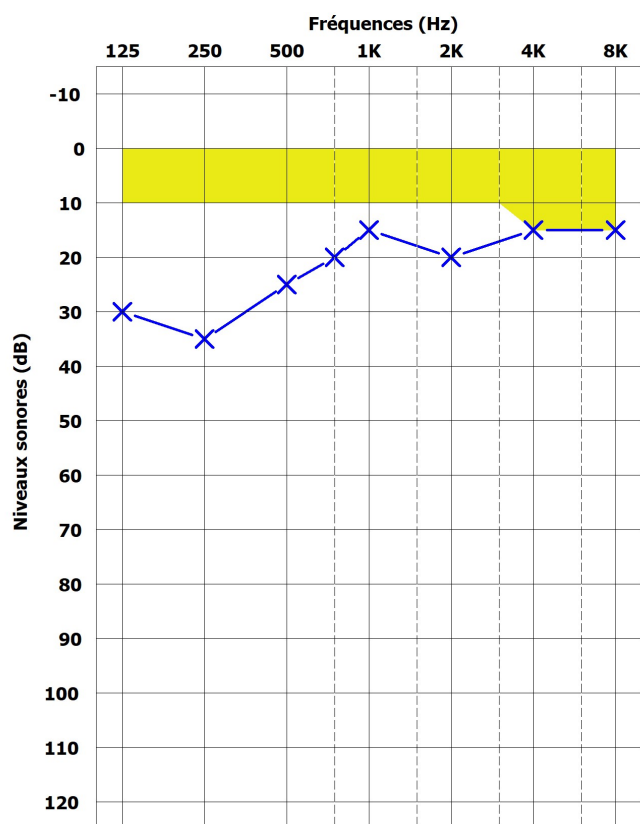

Oreille Gauche

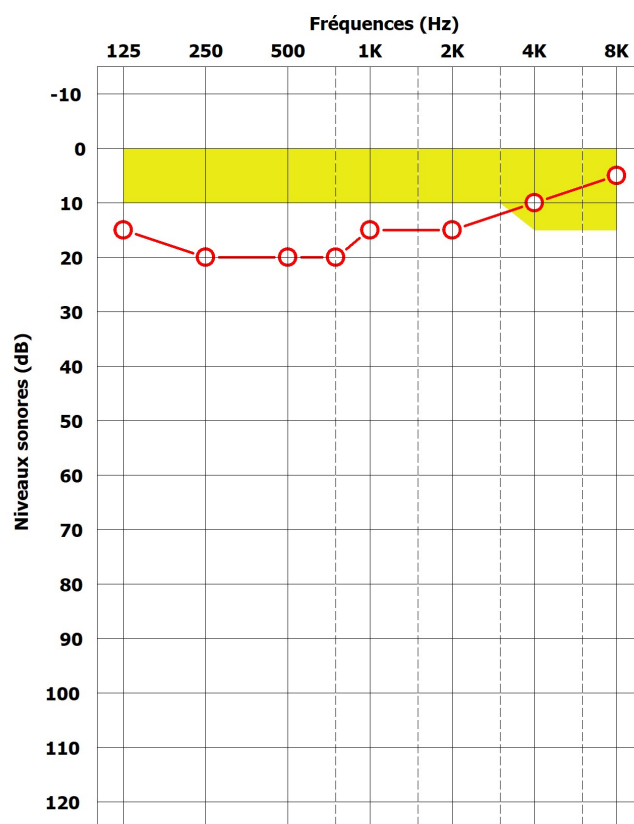

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	35	25	20	15		20		15		15
CA Droit	15	20	20	20	15		15		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes