


MEDVIE


Date du test: 15/04/2024 10:47:04

Durée: 6mn 40s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

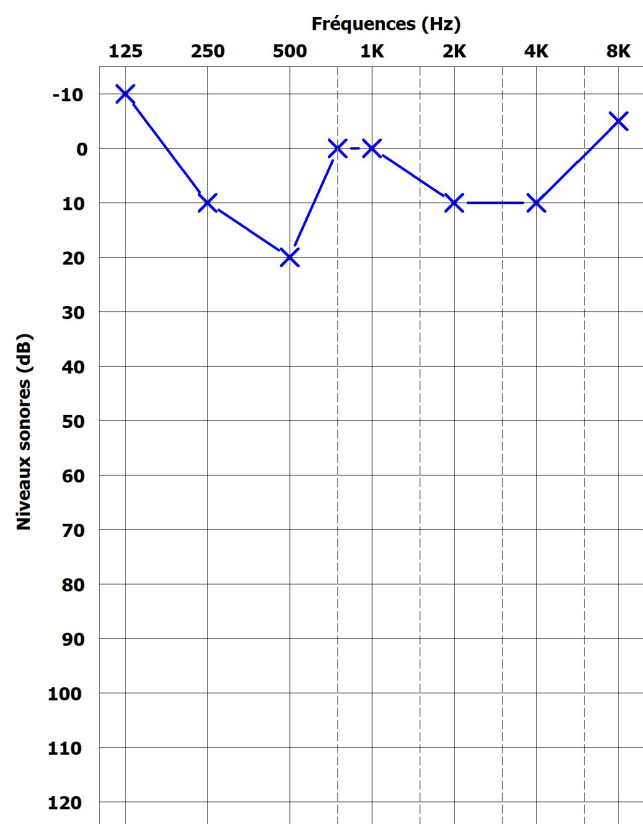

Oreille Gauche

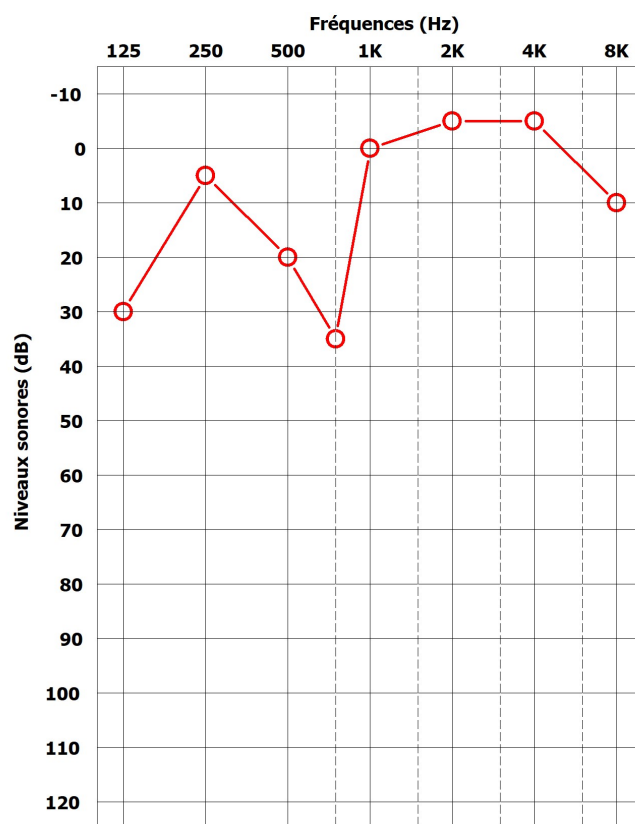

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	-10	10	20	0	0		10		10		-5
CA Droit	30	5	20	35	0		-5		-5		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes

Données Patient

KANTE MOUSSA

Date de naissance

14/01/1980

Age

44

Société

BCEIP

ID

24041510441462201

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021