

MEDVIE


Date du test: 28/03/2024 09:21:25

Durée: 6mn 13s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		FOFANA N'FALY
Date de naissance	01/01/1984	
Age	40	
Société	BCEIP	
ID	24032809184346227	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

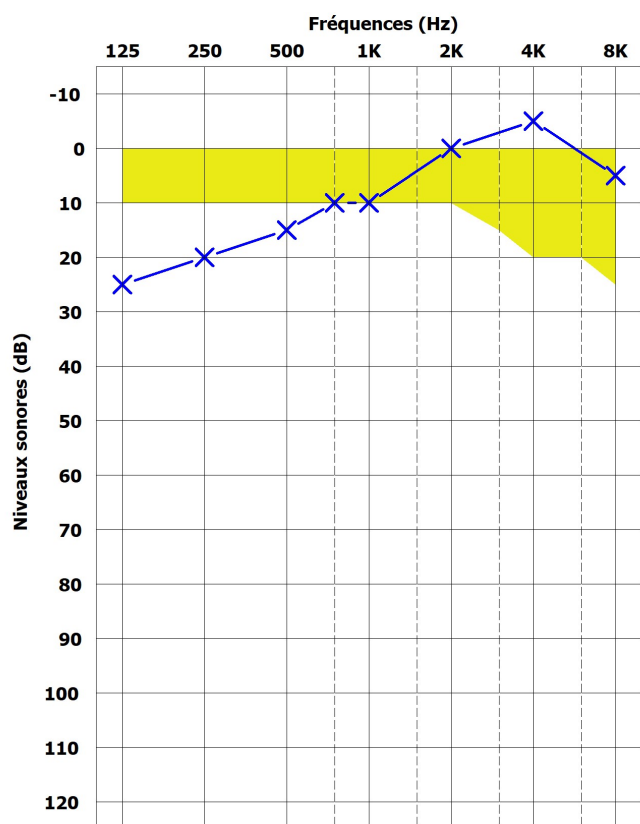

Oreille Gauche

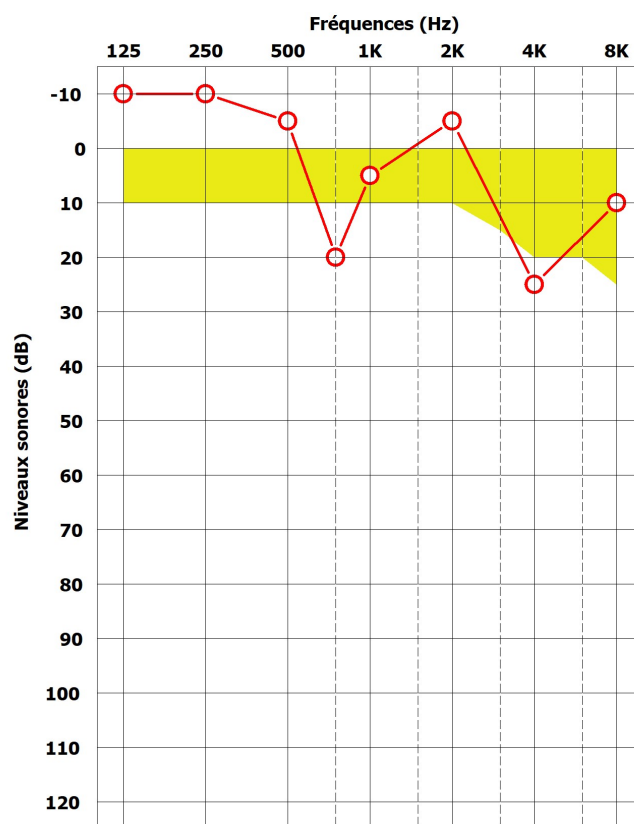

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	20	15	10	10		0		-5		5
CA Droit	-10	-10	-5	20	5		-5		25		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes