


MEDVIE

Date du test: 15/04/2024 13:12:46

Durée: 7mn 09s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

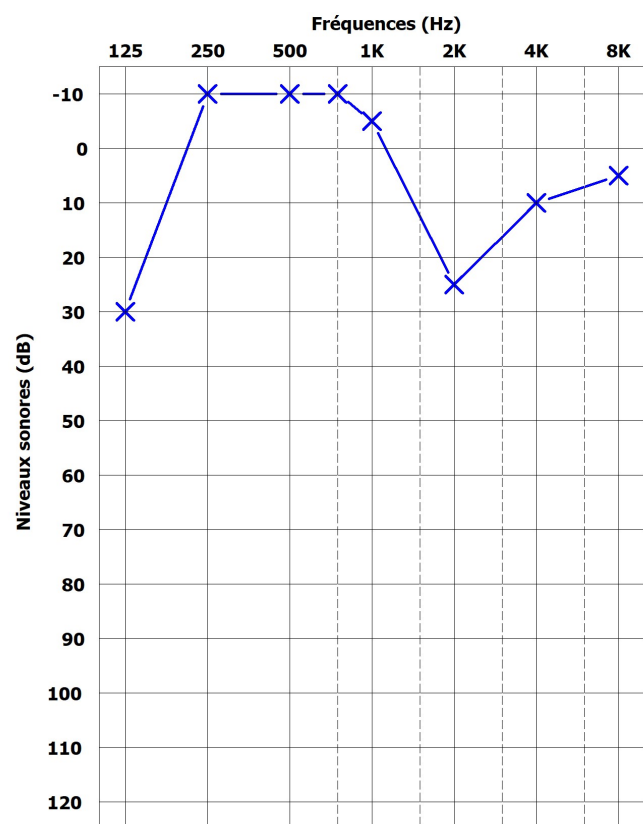

Oreille Gauche

| Données Patient   |                   | CAMARA LAYE |
|-------------------|-------------------|-------------|
| Date de naissance | 19/04/1981        |             |
| Age               | 42                |             |
| Société           | BCEIP             |             |
| ID                | 24041513102408588 |             |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

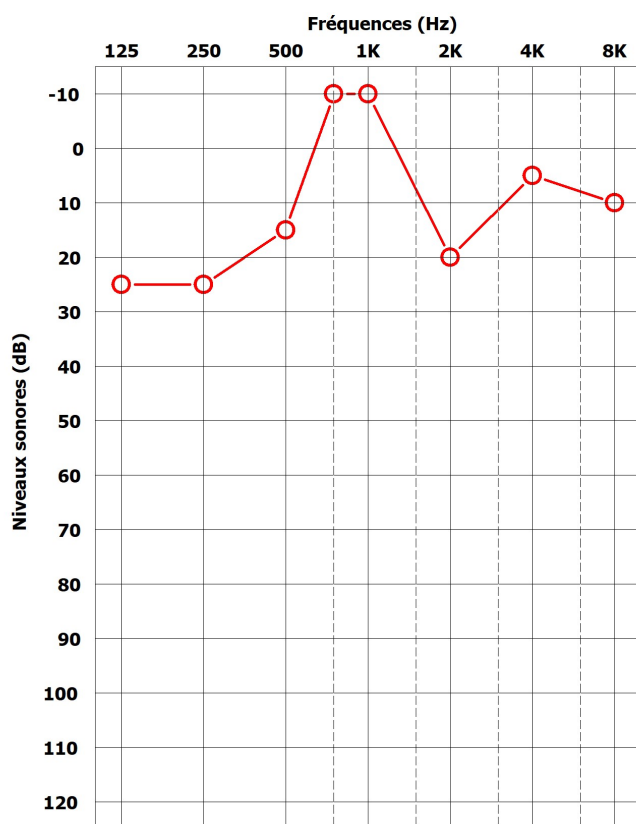

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k  | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | 30  | -10 | -10 | -10 | -5  |     | 25 |    | 10 |    | 5  |
| CA Droit  | 25  | 25  | 15  | -10 | -10 |     | 20 |    | 5  |    | 10 |

| Calcul de perte | PAM    | IPA |
|-----------------|--------|-----|
| CA Gauche       | 5,0 dB | --- |
| CA Droit        | 7,5 dB | --- |

Notes