


MEDVIE

Date du test: 05/07/2024 15:37:40

Durée: 4mn 38s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

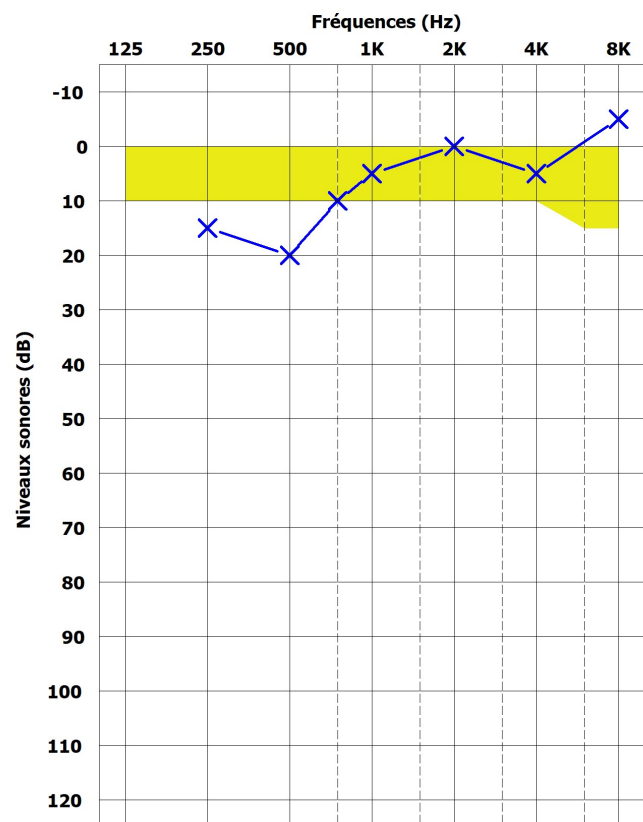

Oreille Gauche

Données Patient		KEITA SEKOU
Date de naissance	01/01/1992	
Age	32	
Société	BCEIP	
ID	24070515360216129	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

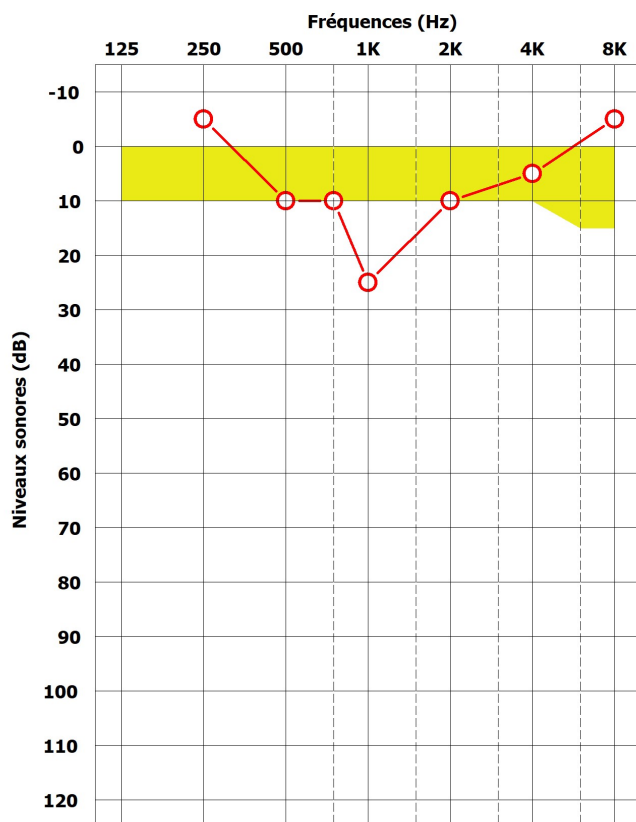

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	10	5		0		5		-5
CA Droit		-5	10	10	25		10		5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes