

MEDVIE

Date du test: 28/03/2024 12:29:48
Durée: 6mn 28s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard


Données Patient

CISSE FODE


Date de naissance: 01/01/1997
Age: 27
Société: BCEIP
ID: 24032812272496996

Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

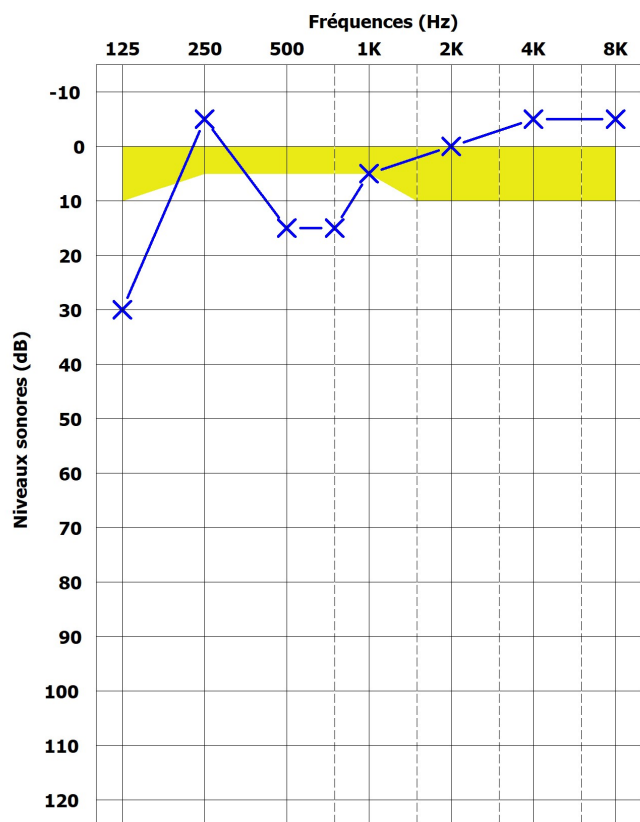

Oreille Gauche

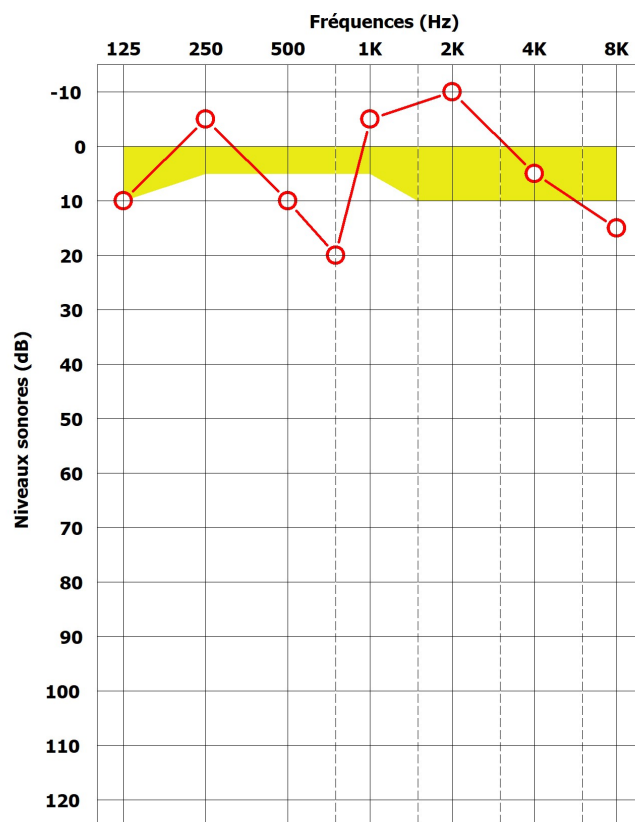

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	-5	15	15	5		0		-5		-5
CA Droit	10	-5	10	20	-5		-10		5		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	3,8 dB	---
CA Droit	0,0 dB	---

Notes