


MEDVIE


Date du test: 05/07/2024 16:25:16

Durée: 3mn 26s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

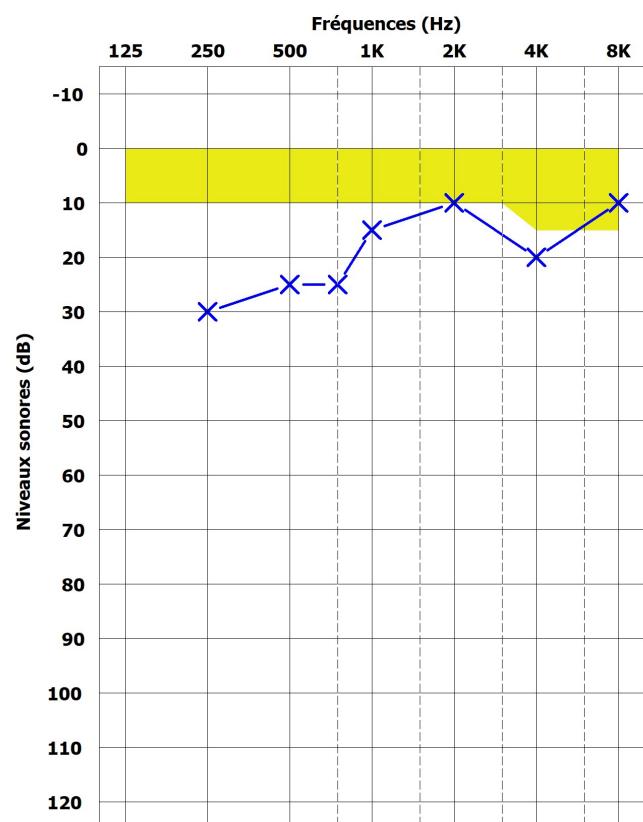

Oreille Gauche

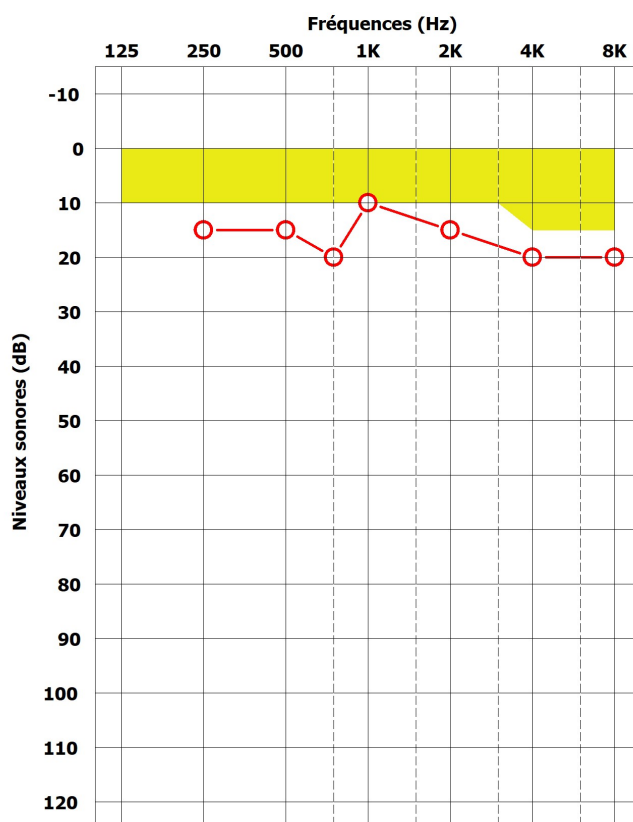

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	25	15		10		20		10
CA Droit		15	15	20	10		15		20		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA SIDIKI
Date de naissance	23/11/1989
Age	34
Société	BCEIP
ID	24070516152415085

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021