

MEDVIE


Date du test: 06/05/2024 15:19:13

Durée: 5mn 36s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIANE AMADOU	
Date de naissance	23/01/1993
Age	31
Société	BCEIP/280
ID	24050615151656751

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

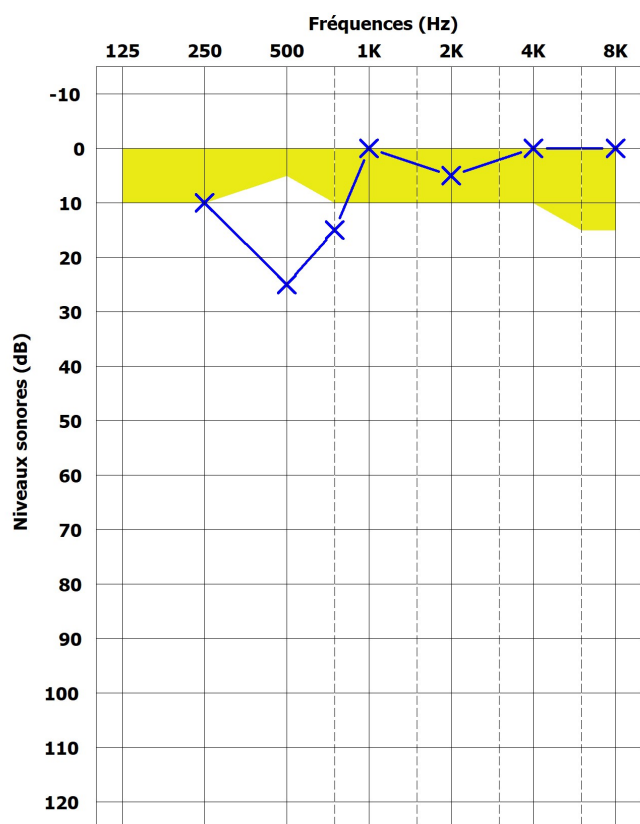

Oreille Gauche

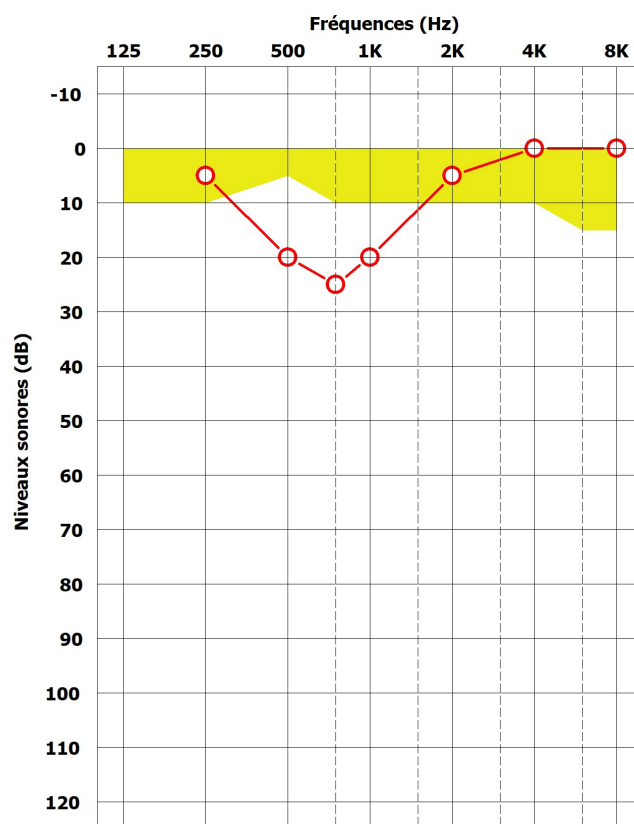

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25	15	0		5		0		0
CA Droit		5	20	25	20		5		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes