


MEDVIE


Date du test: 04/11/2024 13:21:58
Durée: 7mn 20s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	DEMBELE DAOUDA
Date de naissance	01/01/1992
Age	32
Société	BCEIP
ID	24110413143751363

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

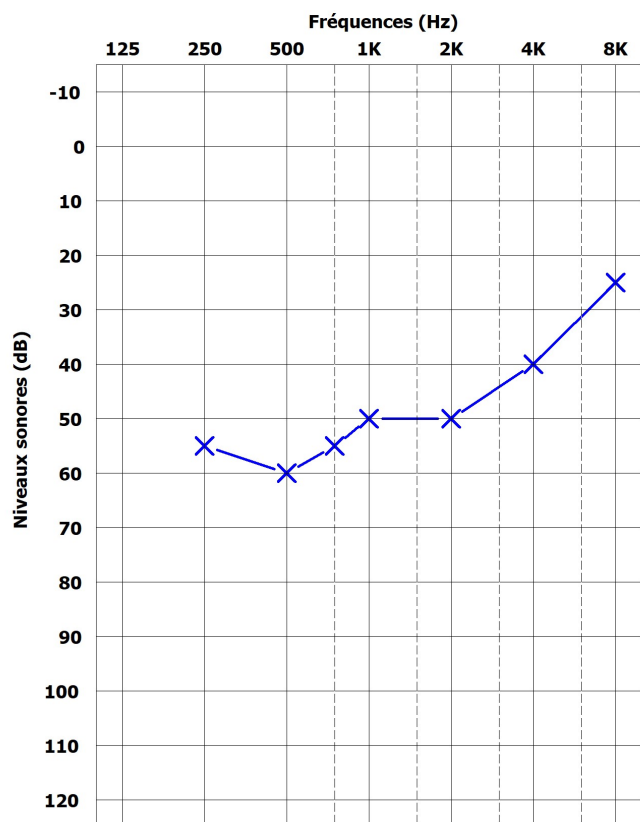

Oreille Gauche

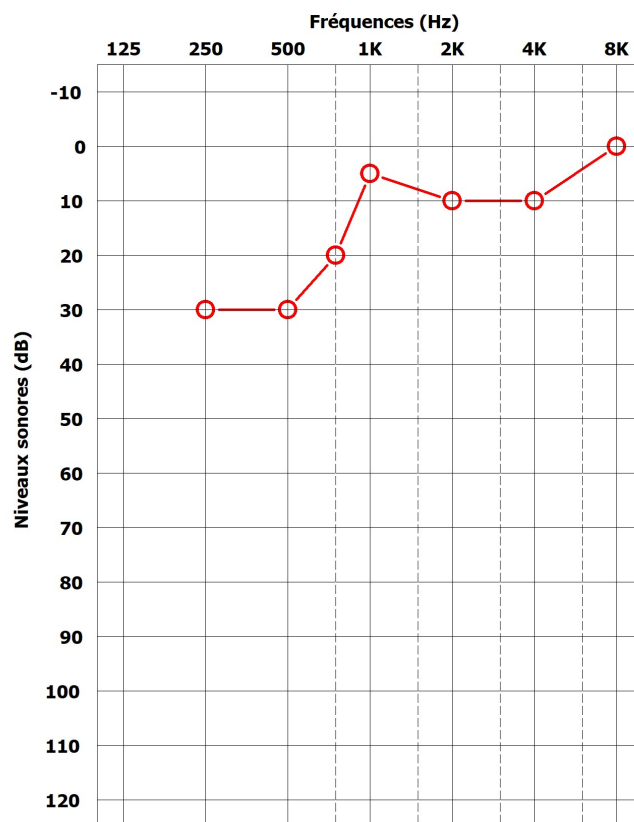

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		55	60	55	50		50		40		25
CA Droit		30	30	20	5		10		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	50,0 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes