

MEDVIE


Date du test: 28/03/2024 11:48:17

Durée: 10mn 17s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KEITA KASSIM	
Date de naissance	01/01/1990
Age	34
Société	BCEIP
ID	24032811451186515

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

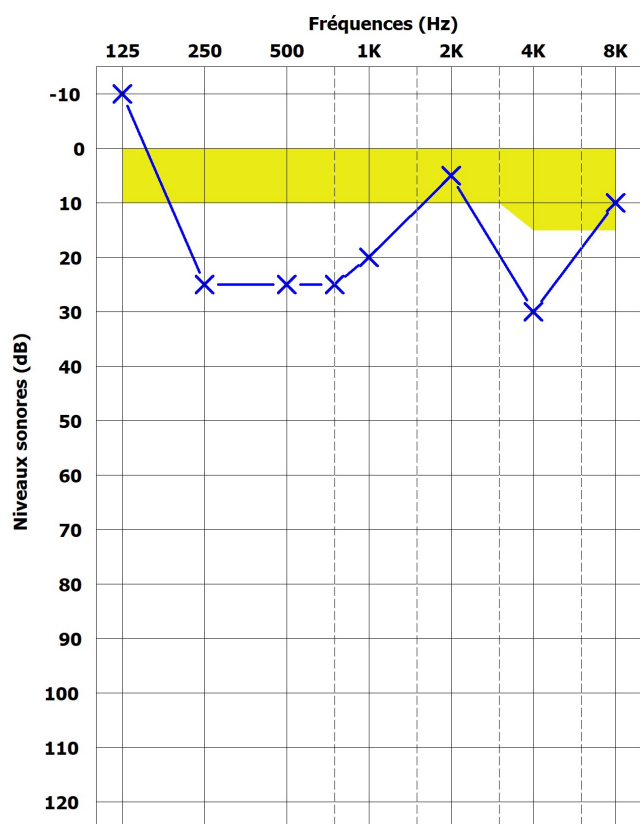

Oreille Gauche

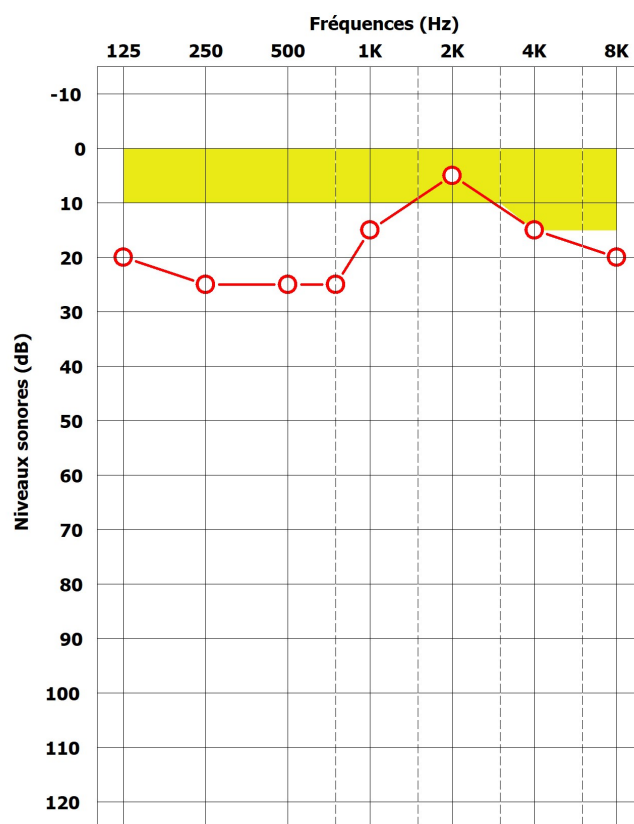

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	-10	25	25	25	20		5		30		10
CA Droit	20	25	25	25	15		5		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes