

MEDVIE


Date du test: 04/11/2024 12:21:57

Durée: 4mn 09s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOMAH Mamady	
Date de naissance	01/07/1981
Age	43
Société	BCEIP
ID	24110412191196465

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

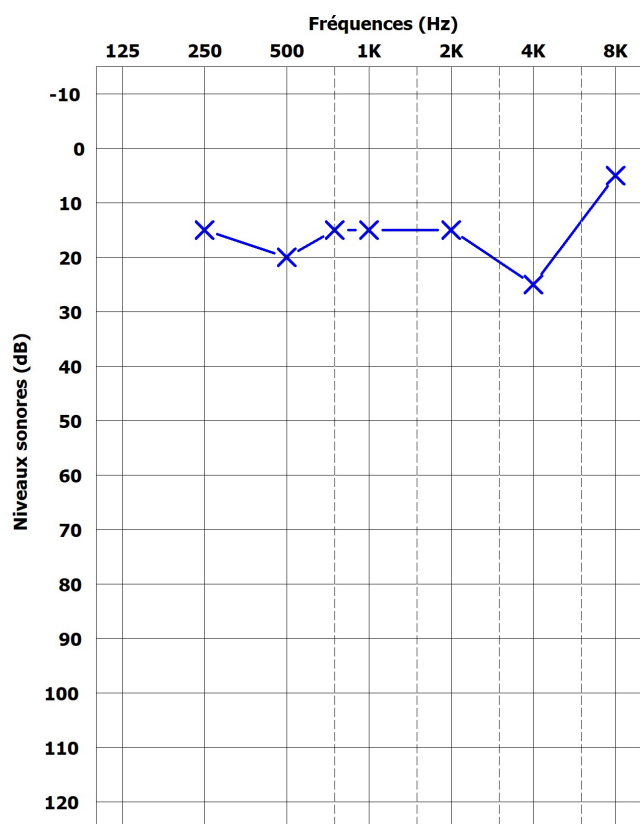

Oreille Gauche

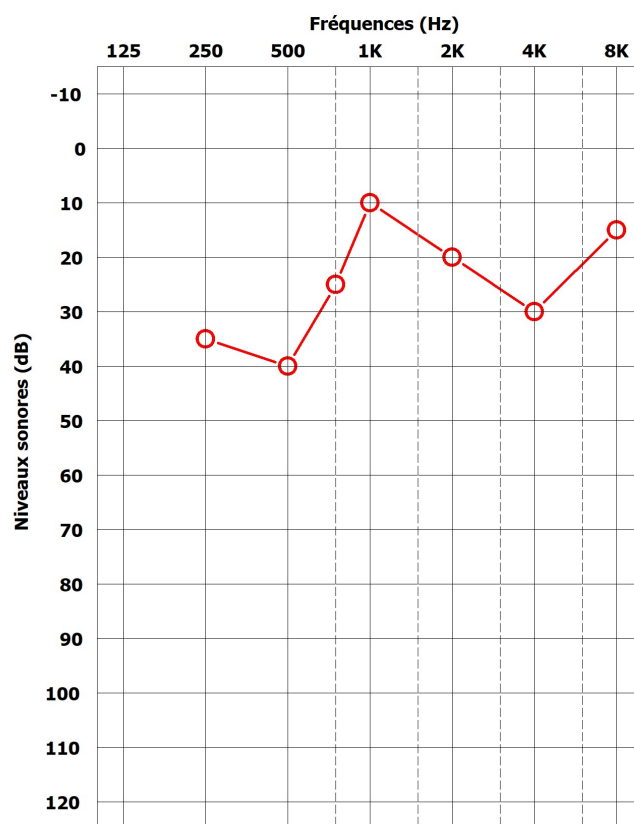

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	15	15		15		25		5
CA Droit		35	40	25	10		20		30		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	25,0 dB	---

Notes