


MEDVIE


Date du test: 06/05/2024 16:19:49  
Durée: 3mn 34s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   | SALL AMADOI DJOULDE |
|-------------------|---------------------|
| Date de naissance | 01/08/1994          |
| Age               | 29                  |
| Société           | BCEIP/287           |
| ID                | 24050616134791542   |

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690092 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |

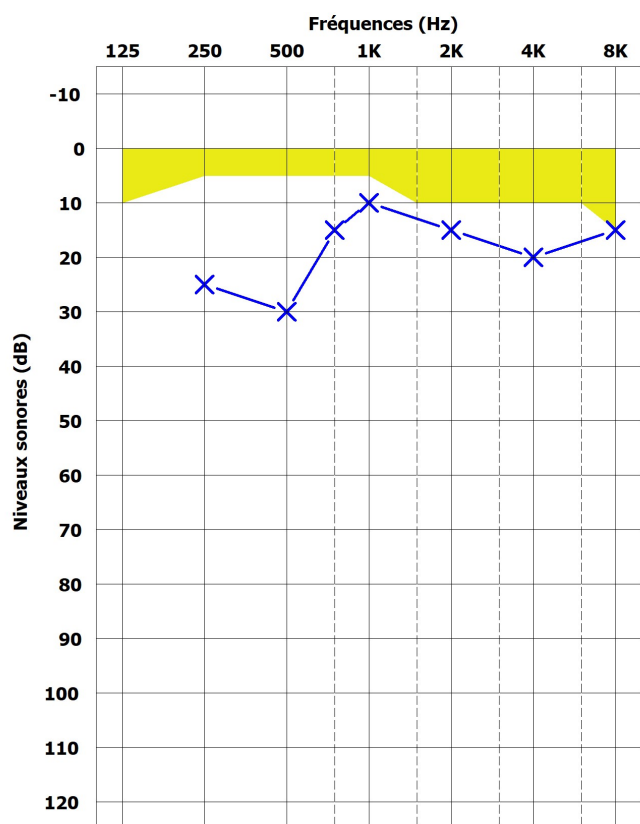

Oreille Gauche

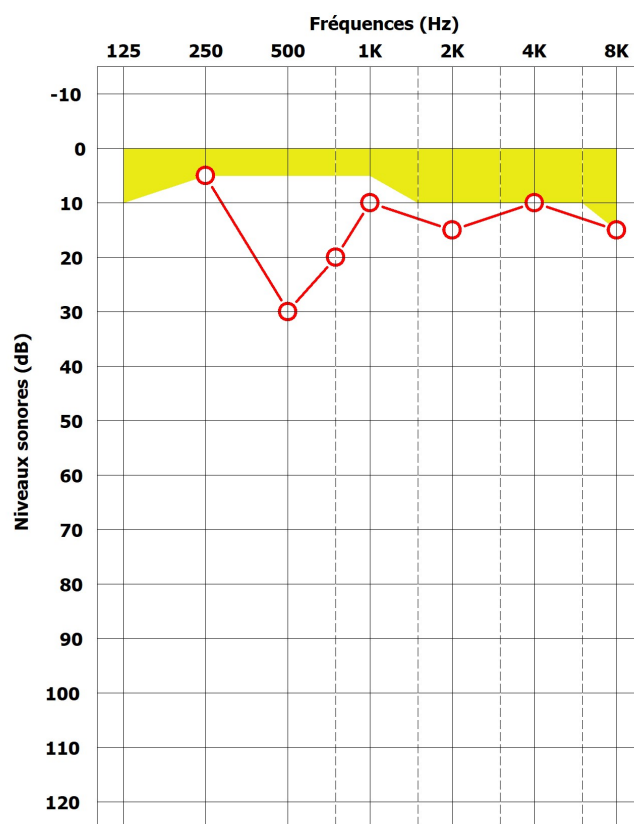

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 25  | 30  | 15  | 10 |     | 15 |    | 20 |    | 15 |
| CA Droit  |     | 5   | 30  | 20  | 10 |     | 15 |    | 10 |    | 15 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 18,8 dB | --- |
| CA Droit        | 16,3 dB | --- |

Notes