

MEDVIE


Date du test: 05/07/2024 14:28:00

Durée: 4mn 30s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
FARO MOHAMED	
Date de naissance	10/04/1986
Age	38
Société	BCEIP
ID	24070514244037478

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

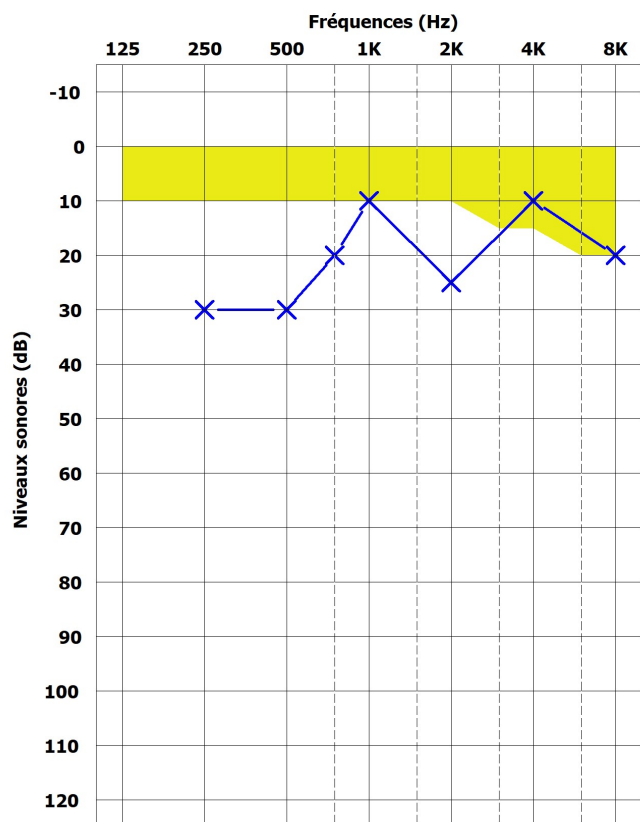

Oreille Gauche

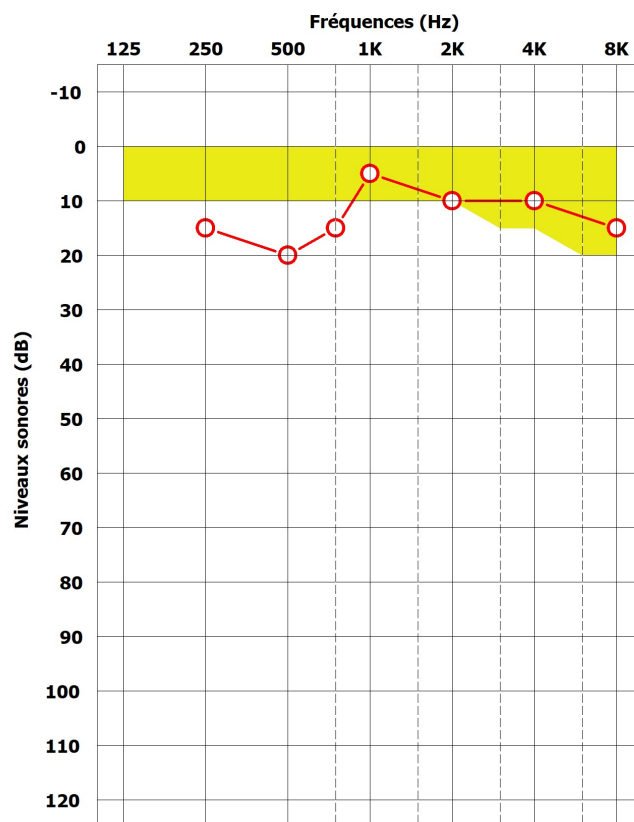

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	20	10		25		10		20
CA Droit		15	20	15	5		10		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes